

Produkt wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych pod numerem PL/DH 001369.

Data nabycia:

w miejscu zakupu termometru lub wysłać uszkodzony termometr na adres: Gwarantuj nie są zwinież objęte batarie i opakowanie. Złożenie reklama- sprowadzone nieprawidłowym użytkownikiem nie są objęte gwarancją.

Uzależnia się wczesniej gwarancji licząc od dnia nabycia. Wszystkie uszkodzenia

GWARANCJA

Vasádas dátuma:
címre:

A vásárlás napótját gárantáljuk váliálbilak a készülőkre. A nem megfelelő készülőből érkező kárkövetéi, valamint az élethez és a csomagolás ártalmi okozott kárkövetéi nem váli- bírlunk gárantáció. Bírmei, más kárkövető gárantációk beárlatkoz. A gárantáció, reklamáció csak az éledektől kezdődő számlával és a gárantációgyel érvényesíthető.

Normy / Szabvány:	EN 12470-3:2000, clinical thermometers
Bateria / Elem:	1,5 / 1,55 V, SR 41
Temperatura przechowywania / Tárolási hőmérséklet:	0d -10 °C do +60 °C
Pamięć / Memória:	Zapamiętywanie ostatniego pomiaru
Signal dźwiękowy / Hangjelzés:	Informacja o gotowości do pracy oraz o zakreśleniu pomiaru, przy zaindowaniu w ciągu 8 sekund wznosi lampki przy wykręceniu 0,01 °C.
Wyświetlacz / Kijataz:	Wyswietlacz cyfrowy (LCD) pokazujący 4 cyfry. Najmniejsza jednostka pomiarowa: 0,01 °C.
Samokontrola / Onkrest:	Automatyczny test wewnętrzny przy temperaturze kontrolnej 37 °C. Przy odczytaniu wskazania 0,1 °C wyswietlana się symbol „EH” (erro).
Temperatura robocza / Üzemeltetési hőmérséklet:	18 °C do 28 °C
Zakres pomiaru / Mérés tartománya:	± 0,1 °C pomiędzy 34 °C a 42 °C Przy temperaturze > 42,99 °C wyswietla się symbol „H” – zbyt wysoka Przy temperaturze < 32,00 °C wyswietla się symbol „L” – zbyt niska
Typ / Típus:	0d 32,00 °C do 42,99 °C Przy temperaturze < 32,00 °C wyswietla się symbol „L” – zbyt niska Przy temperaturze > 42,99 °C wyswietla się symbol „H” – zbyt wysoka
Technika techniczna	Najmniejsza jednostka

poprzez niego pomiaru zostanie skasowany. Pracy. Po dokonaniu następnego pomiaru zostanie skasowany symbol „M” zniknie i termometr powróci do normalnego trybu

pokazuje się symbol „M” (memory – pamięć). Po trzech następnych pomiarach znowu pojawi się symbol „M”. W czasie przeliczenia i twarobczy batarii wyswietlana jest informacja o gotowości do pracy oraz o zakreśleniu pomiaru, przy zaindowaniu w ciągu 8 sekund wznosi lampki przy wykręceniu 0,01 °C.

Wyswietlacz cyfrowy (LCD) pokazujący 4 cyfry. Najmniejsza jednostka pomiarowa: 0,01 °C. Automatyczny test wewnętrzny przy temperaturze kontrolnej 37 °C. Przy odczytaniu wskazania 0,1 °C wyswietlana się symbol „EH” (erro).

± 0,1 °C pomiędzy 34 °C a 42 °C
Przy temperaturze > 42,99 °C wyswietla się symbol „H” – zbyt wysoka
Przy temperaturze < 32,00 °C wyswietla się symbol „L” – zbyt niska

0d 32,00 °C do 42,99 °C
Przy temperaturze < 32,00 °C wyswietla się symbol „L” – zbyt niska
Przy temperaturze > 42,99 °C wyswietla się symbol „H” – zbyt wysoka

Najmniejsza jednostka

WŁĄCZANIE TERMOMETRU
Zależy batarie oraz urządzenia elektryczne muszą być poddane utra- tzeji zgodnie z obowiązyującymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich

Producent zaleca ponowne uwierzytelnienie, we własnym zakresie, co dwa lata. musi być wyjązowy

Do dezynfekcji używaj środków wyszczepiających w rozcień- zeniu i dezynfekcji». Podczas zanurzenia w płynie dezynfekującym termometr nie góli termometru

Nie narażaj termometru na działanie wysokiej temperatury (< 60 °C), NIGDY Chron termometr przed wstrząsami i upadkami

Przed zdesct. Długoo wstawaj, żeby zdesct nie bawły się urządzeniem

Termometr zamiera niewielkie zescti (baterie itd.), które mogą być polniane

Minimalny czas pomiaru sygnalizowany jest dźwiękiem

Urządzenie jest przelazzone tylko do mierzenia temperatury ciała

WAZNE WSKAZÓWKI BEZPECZENSTWA
Kładzenie termometru na czolowej części twarzy może spowodować uszkodzenie termometru

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

Przy użyciu termometru należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, szczególnie w przypadku dzieci

hőmérséklet új mérés kezdeténylezhető.

félsz számköb. Továbbá a mőszorpsc után a memozált értékek eltűnnek és a új értékek megjelennek.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

Az utoljára mérés értéke a hőmérséklet értéke. Ezután egy kis „M” betű lesz látható a jobb oldali kijelzőn. A termometert a következő mérés előtt újra kell kalibrálni.

microlife




100%
Thermometer
GoldTemp
WATERPROOF
ANALLERGIC
TOUCH
BEEPER
FUNCTION



BC MT 1622 GT VarB 5106

GoldTemp Thermometer MT 1622

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT Описание продукта OPIS PRODUKTU A TERMÉK LEÍRÁSA

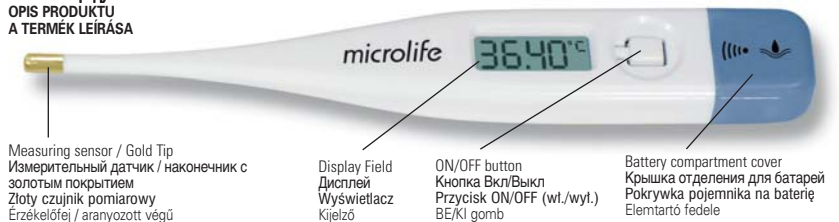

Measuring sensor / Gold Tip
Измерительный датчик / наконечник с
золотым покрытием
Złoty czujnik pomiarowy
Érzékelőfej / aranyozott végű

Display Field
Дисплей
Wyświetlacz
Kijelző

ON/OFF button
Кнопка Вкл/Выкл
Przycisk ON/OFF (wt./wyt.)
BE/KI gomb

Battery compartment cover
Крышка отделения для батарей
Pokrywka pojemnika na baterię
Elemtartó fedele



Anallergic¹
Антиаллергенный¹
Niealergiczny¹
Hipoallergén¹

100 % waterproof
100 %-ная водонепроницаемость
100 % wodoszczelny
100 %-osan vízálló

Signal Tone
Звуковой сигнал
Sygnał dźwiękowy
Hangjelzés

Memory
Память
Pamięć
Memória

¹ no nickel in direct contact with the skin / ¹ нет прямого контакта никеля с кожей
¹ zlotó zamiast niklu w bezpośrednim kontakcie ze skórą / ¹ nem érintkezik nikkellel a bőr

MEASURING METHODS / Способы измерения / METODY POMIAROWE / MÉRÉSI MÓDOK

Method	Time	Temperature Range
Oral орально W ustach Szájban	60 seconds 1 минута 60 sekund 1 perc	Normal 35.7 °C – 37.3 °C
Rectal ректально W odbycie Végbélben	60 seconds 1 минута 60 sekund 1 perc	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar аксиллярно Pod rączką Hónaljban	5-10 minutes * 5 до 10 минут * 5-10 minut * 5-10 perc *	35.2 °C – 36.7 °C

* 5 minutes after beeper (depending on ambient temperature)
* 5 минут после звукового сигнала (в зависимости от окружающей температуры)
* 5 minut po sygnale dźwiękowym (w zależności od temperatury otoczenia)
* 5 perccel a sipóló hang után (a környezeti hőmérséklettől függően)

CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA / TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Name / средства / Szódek / Neve	Immerse / Погружение / Zanurzyć / Tárolhatóság
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours
Спирт этиловый для наружного применения	Погружение на 24 часа

BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ / WYMIANA BATERII / ELEMCSERE

When the «▼»-symbole appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.

Kiedy w prawym dolnym rogu pojawia się symbol odwróconego trójkąta «▼», oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić. W tym celu zdejmij pokrywke pojemnika na baterię. Upewnij się, że jest to bateria tego samego typu, a następnie wymień ją, umieszczając biegunem + ku górze.

Amikor a «▼» (fejére állított háromszög) szimbólum megjelenik a kijelző jobb felső sarkában, akkor az elem kimerült, cserélje ki azt. Az elem kicseréléséhez távolítsa el az elemtartó fedelét. Az új elemet a «+» jellel felfelé helyezze be. Mindig ugyanolyan típusú elemet használjon.

Термометр медицинский электронный
guarantee
(excl. battery)

CE0044
PC
IPM04

CLINICALLY TESTED



Microlife AG
Espanstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com

microlife®

