**Description of this Thermometer**

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor / measuring tip
- ⑤ Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

EN**Cleaning and Disinfecting**

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer). Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.

Battery Replacement

When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type:	Maximum thermometer
Measurement range:	32.0 °C to 43.9 °C
	Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
	Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement accuracy:	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C ± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C
Operating conditions:	10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions:	-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Battery lifetime:	approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class:	IP22
Reference to standards:	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Expected service life:	5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.

Guarantees

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge.
Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

- Transport costs and risks of transport.
- Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
- Damage caused by leaking batteries.
- Damage caused by accident or misuse.
- Packaging/storage material and instructions for use.
- Regular checks and maintenance (calibration).
- Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local Microlife service. You may contact your local Microlife service through our website: www.microlife.com/support

Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «▼» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «▼» symbol symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «▼» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 16 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Attention: For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip.

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute!

ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только на результат измерения.

Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятymi нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Изделие типа BF

Включение термометра

Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①; короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.

Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов подтверждающих исправность прибора.

Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на дисплее ② появляются символ «L» и мигающий символ «▼».

Термометр готов к работе.

Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность измерения) на дисплее выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр не обходимо заменить.

Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. В процессе измерения осуществляется непрерывное отображение фактической температуры. Символ «▼» мигает в течение всего этого времени. Если звуковой сигнал и перестает мигать символ «▼», это означает, что скорость измерения температуры замедлилась (за 16 секунд температура не изменилась на 0,1 °C).

Для продления срока службы термометра выключите термометр кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ①. Автоматически термометр выключается примерно через 10 минут.

Сохранение результатов измерения

При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ① больше 3 секунд при включении термометра на дисплее отображается максимальная температура, автоматически сохраненная во время последнего измерения. При этом на дисплее отображается символ «M» (память). Через 2 секунды после того, как кнопка была отпущена, значение температуры исчезает, и термометр готов к новому измерению.

Способы измерения / Нормальная температура тела

► В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34.7 - 37.3 °C

Протрите область подмышечной впадины спиртом. Поместите измерительный датчик ④ под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и прижмите рукой пациенту рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания.

► В рту (оральное) / 35.5 - 37.5 °C

Не щёлкните и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Подержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от языка. Измерительный датчик ④ должен находиться в хорошем контакте с языками. Закройте рот и равномерно дышите носом, чтобы выдыхаемый воздух не влился в результат измерения.

► В заднем проходе (ректально) / 36.6 - 38.0 °C

Внимание: для предотвращения возможной травмы прямой кишки и детей (младше 3 лет) мы рекомендуем использовать другой метод измерения или использовать термометр с кибиком наконечником.

Осторожно введите измерительный датчик ④ термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.

Рекомендуется использовать гигиенический копчик и смазку. Если вы не уверены в этом методе измерения, вам следует проконсультироваться с квалифицированным персоналом для руководства / обучения.

Приблизительное время измерения: 1 минута!

► В горле (орали) / 35.5 - 37.5 °C

Не щёлкните и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Подержите горло закрытым за 2 минуты до начала измерения.

Закройте термометр на окончании гортани на 2-3 сантиметра. Внимание: для измерения температуры тела человека оральным, ректальным или подмышечным (аксиллярным) способами. Не пытайтесь измерять температуру в других местах, например, в ухе, так как это может привести к ложным показаниям и стать причиной травмы.

► Не используйте изделия, если Вам кажется, что они повреждены, или если Вы заметили что-либо необычное.

Мы рекомендуем чистить это устройство для личной гигиены перед первым использованием в соответствии с инструкциями.

► Минимальное время измерения до появления звукового сигнала обязательно должна соблюдаться!

► Звуковой сигнал в термометре не говорит об окончании измерения, необходимо продолжить измерение еще в течение 1-5 минут, в зависимости от способа измерения, см. раздел «Способы измерения / Нормальная температура тела».

► По соображениям безопасности (риск травмирования прямой кишки) измерение рекомендуется только обученным медицинским персоналом (профессиональным пользователем). Вместо этого используйте другой метод измерения. Для измерения ректальным способом у маленьких детей младше 3 лет имеются термометры с кибиком наконечником!

► Не пытайтесь проводить измерение ректальным способом у лиц с нарушениями ректального характера. Это может усугубить имеющиеся расстройства.

► Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглатаны. При поставке прибора с кабелями и шлангами возможен риск задушения.

► Не используйте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями. Во время использования устройства минимальное расстояние от источников таких полей должно составлять 3,3 м (m).

► Оберегайте прибор от ударов и падений!

► При хранении и использовании прибора температура окружающей среды не должна превышать 60 °C. НИКОДАГДА не подвергайте прибор кипячению!

► Для чистки устройства используйте только дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «Чистка и дезинфекция», чтобы избежать повреждения устройства.

► Мы рекомендуем проверять это устройство на точность каждые два года или после механического удара (например, падение). Пожалуйста, свяжитесь с местным сервисом Microlife чтобы организовать тест.

► На данном устройстве распространяется «пожизненная» гарантia со дня покупки. В течение этого гарантийного периода, по нашему усмотрению, Microlife бесплатно отремонтирует или заменит неисправный продукт.

Вскрытие или измение устройства аннулирует гарантii.

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

► Гарантii

На данном устройстве распространяется «пожизненная» гарантia со дня покупки. В течение этого гарантийного периода, по нашему усмотрению, Microlife бесплатно отремонтирует или заменит неисправный продукт.


Проверка или измение устройства аннулирует гарантii.

► Транспортные повреждения и риски, связанные с транспортом.

► Повреждения, вызванные неправильным применением или несоблюдением инструкции по применению.

Повреждения, вызванные утечкой батареи.

► Повреж

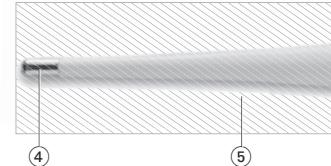

Popis teplomeru SK

- 1 Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
- 2 displej
- 3 Kryt priestoru pre batériu
- 4 Meraci smeriací / meraci hrot
- 5 Cislici a dezinfekčný priesitor (iba sonda teplomera)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Postupujte podľa návodu používania. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto prístroja. Pred používaním prístroja si dokladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na ďalšie použitie.
- Tento prístroj je možné použiť len pre meranie ľudskej telesnej teploty orálnu, rektálnu alebo axílnu (v podpazu). Nepoukážte sa merat teplotu na iných miestach, ako napríklad v úchu, pretože by to mohlo viesť k chybnému výsledku merania a môže to spôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak si myslíte, že je poškodený alebo si naň vymyslite niečo nezvyčajné.
- Kvôli osobnej hygiene odporúčame pred prvým použitím prístroja očistiť podľa pokynov na čistenie.
- Vždy je nutné doždávať minimálny čas merania, kým sa neozvee signál!

Vezmite na vedomie, že rôzne miesta merania môžu vyžadovať pokračovanie merania až po zaznení zvukového signálu, pozrite kapitolu „Metódy merania / Normálna telesná teplota“.

- Z bezpečnostných dôvodov (riziko perforácie rektá) musí rektálne meranie u detí mälsich až 3 roky vykonávať iba školený zdravotnícky personál (profesionálny užívateľ). Použite preto inú metódu merania. Na meranie rektálnej teploty u malých detí mälsich než 3 roky sú k dispozícii teplomery s pružnou špičkou.
- Nepoukážte sa o rektálne meranie osobe s poruchami konečnika. Môže to prehĺbiť alebo zhrozit očorenie.
- Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru; niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehĺbiť. Buďte si vedomi rizika nehody v prípade, ak je prístroj dodávaný s káblami alebo hadičkami.

• Nepoužívajte prístroj blízko silných elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefón alebo rádiové zariadenia. Dôždrujte minimálnu vzdialenosť 3 cm od týchto zariadení, ak používate prístroj.

• Výrobok chráňte pred pádnou a nárazmi!

• Výrobok nevystavujte teplom až do 60 °C. Teplomer NEVYVÁRAJTE!

• Na čistenie prístroja používajte iba komerčné dezinfekčné prostriedky uvedené v časti „Čistenie a dezinfekcia“, aby ste predišli poškodeniu prístroja.

• Odporúčame tento prístroj testovať na presnosť každé dva roky alebo po mechanickom náraze (napr. páde). Kontaktujte mestrov servis Microlife a požiadajte o výkonanie testu.

APOZORNENIE: Výsledok merania daný týmto prístrojom nie je diagnóza! Nespoliehať sa len na výsledok merania.

Batéria a elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestne platnémi predpismi, nie s domácim odpadom.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

Priľnožné časti typu BF.

Zapnutie teplomera

Teplomer zapnete stlačením tlačidla ON/OFF (1); krátke bipnutie signalizuje, že je teplomer zapnutý. Prebehne test displeja. Všetky segmenty by sa malí zobraziť.

Ak je teplomač okolia nižšia než 32 °C, na displeji (2) sa objaví «L» a signál «C», teplomer je prípravovaný na použitie.

Funkčná skúška

Správna funkcia teplomera je automaticky testovaná pri každom zapnutí. V prípade zistenia poruchy (nepresné meranie), sa na displeji objavi «ERR» a meranie nie je možné vykonať. V tom prípade je nutné teplomer vymeniť.

Použitie teplomera

Vyberte si preferovanú metódou merania. Pri meraní sa nepretržite zobrazuje aktuálna teplota a blikajúci symbol «C». Ak 10 krát zaznie zvukový signál a symbol «C» prestane blikat, známenie to, že zmeraný náfrast teploty je menší než 0,1 °C za 16 sekúnd.

Zivotnosť batérie predikuje, ak teplomer využíva krátkym stlačením tlačidla ON/OFF (1). Ak tlačidlo nestlačíte, teplomer sa automaticky vypne prílišne po 10 minútach.

Uloženie nameraných hodnôt

Ak tlačidlo ON/OFF (1) pridržíte pri zapnutí stáčané dlhšie než 3 sekundy, automaticky sa zobraží najväčšia naposled zmeraná teplota. Súčasne sa na displeji objaví symbol «M». Približne 2 sekundy po uvoľnení tlačidla hodnota teploty zmizne a teplomer je prípravovaný na meranie.

Metódy merania / Normálna telesná teplota

► V podpazužnej jamke (axílnom) / 34,7 - 37,3 °C

Utrte podpazužne suchou utierkou. Meraci senzor (4) umiestnite pod rameno do stredu podpazužia tak, aby sa hrot dotýkal pokôzky a rameno pacienta príloži k jeho telu. To zaistí, že vzhľad v miestnosti neovplyvní meranie. Na to, aby sa v podpazuži dosiahla stabilná teplota, je potrebný dlhší čas, preto počkajte aspoň 5 minút, bez ohľadu na zvukový signál.

► V ústach (orálnom) / 35,5 - 37,5 °C

10 minút pred meraním nejdete ani neptej si hočere alebo studené. Pred začiatkom merania majú byť usta zatvorené aspoň 2 minuty.

Teplomer zasúte do jednej z dvoch priepliniek pod jazykom, naľavo alebo napravo od koreňa jazyka. Meraci smeriací (4) musí mať dobrý kontakt s krvnou žilou. Zavrite usta a rovnomenne dýchajte nosom, aby meranie nebolo ovplyvnené výduchom/vydýchaním vzhľadom. Ak to nie je možné z dôvodu zlepšovacích dýchacích cest, mala by sa použiť iná metoda merania.

Prib. čas merania: 1 minúta!

► V konečniku (rekálne) / 36,6 - 38,0 °C

Upozornenie: Na prevenčiu perforácie konečnika u detí (mälsich až 3 roky) odporúčame použiť inú metódou merania alebo použiť teplomer s pružnou špičkou.

Meraci smeriací (4) opatne zasúte 2 až 3 cm do análneho otvoru. Odporúčame použiť kryt sondy a lubrikant.

Ak si ste stí tohto metoda merania, poradte sa s odborníkom, ktorý vás zaskočí/zavíci.

Prib. čas merania: 1 minúta!

Čistenie a dezinfekcia

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny

Na dezinfekciu v domácom prostredí použite tampon so 70% izopropylalkoholem alebo balvňenou kaninou navlhčenou 70% izopropylalkoholom, aby ste zo snímača teplomera utrieľ povrch znečistňujúce látky (poznámka: dodržte návod na použitie a bezpečnostné pokyny