

## Description of this Thermometer

EN

- ① Multifunction button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor
- ⑤ Body mode
- ⑥ Water bath mode
- ⑦ Ambient mode

## Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the instrument from impact and dropping!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the instrument.
- We recommend this instrument is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact Microlife-Servizio to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

## Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the multifunction button ①; a short beep signals «thermometer ON» and a red and green backlight lights up. A display test is performed. All segments should be displayed.

## Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «Err» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

## Select the Measuring Mode

Press the multifunction button ① to select the desired mode; the device will set up the chosen mode if there is no switch within 3 seconds. After the mode selection is completed, the thermometer is ready for use.

## Using the Thermometer

**Measuring in body mode ⑥** The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 34 °C, «-->» and «<--» appear on the display field ②. The thermometer is ready for use now. Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and flashes. If a long beep is heard and the displayed temperature is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

4 short beeps and a red LCD backlight alert the patient that he/she may have a temperature equal to or higher than 37.5 °C. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

## Measuring in water bath mode ⑥

The temperature will be displayed continuously without backlight when the temperature is between 5 - 50 °C.

## Measuring in ambient mode ⑦

The temperature will be displayed continuously without backlight when the temperature is between -10 - +50 °C.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the multifunction button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 5 minutes.

## Measuring methods / Normal body temperature

## In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air.

Approx. measuring time: 8 seconds!

## In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

Approx. measuring time: 8 seconds!

## In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 5-10 minutes is recommended regardless of the beep sound.

## Cleaning and Disinfecting

Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.

## Battery Replacement

The battery needs replacing, when only the «battery»-symbol appears on the display. Remove the battery compartment cover ③ from the thermometer, to replace the battery. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

## Technical Specifications

## Type: Predictive maximum thermometer

**Measurement range:** Body mode: 34 - 43.9 °C  
Temp. < 34.0 °C: display «-->» for low (too low)  
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)  
Water bath mode: 5 - 50 °C  
Temp. < 5 °C: display «L» for low (too low)  
Temp. > 50 °C: display «H» for high (too high)  
Ambient mode: -10 - +50 °C  
Temp. < -10 °C: display «Err» for low (too low)  
Temp. > 50 °C: display «H» for high (too high)

**Measurement accuracy:** Body mode: ± 0.1 °C between 34 - 43.9 °C  
Water bath mode: ± 1 °C between 5 - 50 °C  
Ambient mode: ± 1 °C between -10 - +50 °C

**Operating conditions:** 10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity  
**Storage conditions:** -25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity

**Battery:** 3V, CR1632

**Battery lifetime:** approx. 2000 measurements (using a new battery)

**IP Class:** IP67

**Reference to standards:** EN 12470-3, clinical thermometers;  
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);  
IEC 60601-11

**Expected service life:** 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.  
Technical alterations reserved.

## Guarantee

We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well and send with sufficient postage to the Microlife distributor.



## Description of this Thermometer

ES

- ① Botón multifunción
- ② Pantalla
- ③ Tapa del compartimento de la batería
- ④ Sensor de medición
- ⑤ Modo de Cuerpo
- ⑥ Modo baño de agua
- ⑦ Modo temperatura ambiente

## Instrucciones importantes de seguridad

- Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y conservelo para futuras consultas.
- Este instrumento debe usarse únicamente para medir la temperatura corporal!
- Se debe respetar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de bip!
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunas de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- No use el dispositivo cerca de fuertes campos electromagnéticos de gran intensidad, por ejemplo a proximidad de teléfonos portátiles o de instalaciones radio. Mantener una distancia mínima de 3,3 metros de estos aparatos lors de toute utilisation.
- Proteger el instrumento de impactos y caídas!
- Evitar exponer el instrumento a temperaturas ambientales superiores a 60 °C. NO SUMERGERE el instrumento en agua caliente!
- No exponer el instrumento a temperaturas ambientales inferiores a 60 °C. NUNCA debe hervir el instrumento!
- Para proceder al lavado, no utilizar que los desinfectantes repartidos en el parágrafo «Nettoyage y desinfección».
- Nous recommandons de faire contrôler la précision de cet instrument tous les deux ans ou après un choc mécanique (par ex. chute). Veuillez contacter le Service Microlife pour convenir d'une révision.

**ADVERTENCIA:** La medida entregada por este termómetro no constituye un diagnóstico! No se suele ser único resultado de la medida.

**ADVERTENCIA:** El resultado de la medición dado por este dispositivo no es un diagnóstico! No confie sólo en el resultado de la medición.

Las pilas y los dispositivos electrónicos deben eliminarse según las normativas locales pertinentes y no se deben desechar junto con la basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

**Pieza aplicada tipo BF**

## Mise en marche du thermomètre

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton multifonction ①; un bref bip indique que le «thermomètre est en marche» et un rétro-éclairage rouge et vert s'allume. Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

**Pieza aplicada tipo BF**

## Puesta en marcha del termómetro

Para activar el termómetro, pulse el botón multifunción ①; un breve pitido o señal de bip indica que el «termómetro está encendido» y se ilumina una luz de fondo roja y verde. Se realiza una prueba de pantalla. Todos los íconos deben aparecer en la pantalla.

**Prueba de funcionamiento**

Le funcionamiento del termómetro es testeado automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante «Err» en la pantalla ②. Una vez que se completa la selección de modo, el termómetro debe sustituirse.

## Selección del modo de medición

Presione el botón multifunción ① para seleccionar el modo deseado; El dispositivo configurará el modo elegido si no hay un cambio en 3 segundos. Una vez que se completa la selección de modo, el termómetro está listo para su uso.

## Usos del termómetro

## Medición en el modo de cuerpo ⑥

La última lectura de medición se visualiza en el display ② automáticamente durante 2 segundos con el ícono «M».

Si la temperatura ambiente es inferior a 34 °C, una «-->» y un «<--» aparecen en la pantalla ②. Ahora, el termómetro está preparado para realizar la medición de la temperatura.

Elija el método de medición preferido. Al tomar una medición, la temperatura actual se visualiza continuamente y parpadea. Si se oye un pitido largo y la temperatura mostrada ya no parpadea, la temperatura predictiva final ha sido determinada y el termómetro puede ser leído.

Cuando el dispositivo emite 4 pitidos cortos y se enciende la luz de pantalla roja, el dispositivo indica al paciente que la temperatura es igual o superior a 37,5 °C. Referencia: temperatura oral.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo entre las mediciones.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

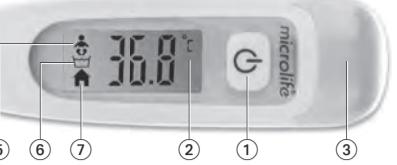
Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 5 minutos.

## Medición en modo de baño de agua ⑥

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre 5 - 50 °C.

## Medición en modo ambiente ⑦

La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura esté entre -10 - +50 °C.

**Descrição do termómetro**

- (1) Botão multifunções  
(2) Visor  
(3) Tampa do compartimento da pilha  
(4) Sensor de medição  
(5) Modo de medição da temperatura corporal  
(6) Modo temperatura da água  
(7) Modo ambiente

**Instruções de segurança importantes**

- Siga as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseamento e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.
- E necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro sem emitido.
- Certifique-se de que não deixa o dispositivo ao alcance das crianças, algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento ao risco de estrangulamento no caso deste dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.
- Não utilize o dispositivo na proximidade de campos electromagnéticos fortes, tais como, telemóveis ou instalações radiofónicas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.
- Proteja o instrumento contra impactos e quedas!
- Evite dobrar a extremidade mais de 45°!
- Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!
- Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção» para limpar o instrumento.
- E recomendada a realização de testes ao instrumento, de dois em dois anos, para manutenção das níveis de precisão ou após impacto mecânico (por ex. queda). Contacte o Serviço de Assistência da Microlife para providenciar o teste.

**Aviso:** O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

**Peça aplicada tipo BF****Ligar o termômetro**

Para ligar o termômetro, pressione o botão multifunções (1); um breve sinal sonoro indica que «o termômetro está ligado (ON)» e as luzes de fundo vermelha e verde acendem. É efetuado um teste ao visor. Deverão visualizar-se todos os ícones.

**Teste de funcionamento**

O funcionamento correto do termômetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação «Err», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termômetro.

**Selección o modo de medição**

Pressione o botão multifunções (1) para selecionar o modo desejado. O dispositivo irá configurar o modo escolhido se não houver nenhuma troca dentro de 3 segundos. Depois da seleção do modo estar concluída, o termômetro está pronto a ser utilizado.

**Utilização do termômetro****Medição no modo de temperatura corporal (5)**

Uma medição efetuada será indicada no visor (2) automaticamente durante 2 segundos com o ícone «M».

Em seguida, a uma temperatura ambiente inferior a 34 °C, são apresentados os símbolos «--» e «°C» no visor (2). O termômetro pode agora ser utilizado.

Escolha o modo de medição pretendido. Ao efectuar uma medição, a temperatura atual é exibida continuamente e piscava. Se for usado um termômetro bimodal, a temperatura exibida no visor não piscará, o valor final da temperatura foi determinado e é possível ler-se agora o resultado final.

4 breves sinais sonoros e o piscar do visor LCD alertam o doente para o facto de poder ter uma temperatura igual ou superior a 37,5 °C.

Referência: temperatura oral.

Para alcançar resultados comparáveis permite 1 minuto de intervalo entre as medições.

**Medição no modo temperatura da água (6)**

A temperatura será exibida continuamente sem luz de fundo quando a temperatura estiver entre 5 - 50 °C.

**Medição no modo ambiente (7)**

A temperatura será exibida continuamente sem luz de fundo quando a temperatura estiver entre -10 + 50 °C.

Para prolongar a duração da pilha, desligue o termômetro pressionando por breves instantes o botão multifunções (1). Caso contrário, o termômetro será automaticamente desligado após 5 minutos.

**Métodos de medição / Temperatura corporal normal****Na boca (oral) / 35,5 - 37,5 °C**

Coloque o termômetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do fredo da língua. O sensor de medição (4) tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/expiração.

**Tempo de medição aproximado: 8 segundos!****No ânus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C**

Este é o método de medição mais fiável e é especialmente indicado para bebés e crianças. Introduza cuidadosamente o sensor de medição (4) do termômetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

**Tempo de medição aproximado: 8 segundos!****Debaixo do braço (axilar) / 34,7 - 37,3 °C**

Para obter resultados mais fáceis recomendamos que a temperatura seja medida nas cavidades oral ou rectal. A medição deve ser efetuada durante pelo menos 5-10 minutos independentemente do sinal sonoro.

**Limpeza e desinfecção**

Nome: Álcool isopropílico 70%; submergir: máx. 24 horas.

**Substituição da pilha**

A pilha deve ser substituída somente quando o símbolo «pilha» aparecer no visor. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha (3) do termômetro. Introduza uma nova pilha colocando o sinal + virado para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

**Especificações técnicas**

- Tipo:** Termômetro de máxima prelviditividade  
**Gama de medição:** Modo de medição da temperatura corporal: 34 - 43,9 °C  
Temp. < 34,0 °C, é visualizado o símbolo «--» correspondente a temperatura baixa (demasiado baixa)  
Temp. > 50 °C é visualizado o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)  
Modo temperatura da água: 5 - 50 °C  
Temp. < 5 °C é visualizado o símbolo «L» correspondente a temperatura baixa (demasiado baixa)  
Temp. > 50 °C é visualizado o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)  
Modo temperatura ambiente: -10 - 50 °C  
Temp. < -10 °C é visualizado o símbolo «L» correspondente a temperatura baixa (demasiado baixa)  
Temp. > 50 °C é visualizado o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)
- Precisão da medição:** Modo de medição da temperatura corporal: ± 0,1 °C entre 34 - 43,9 °C  
Modo temperatura da água: ± 1 °C entre 5 - 50 °C  
Modo ambiente: ± 1 °C entre -10 - 50 °C

**Condições de funcionamento:** 10 - 40 °C; 15-95 % humidade relativa máxima**Condições de acondicionamento:** -25 - +60 °C; 15-95 % humidade relativa máxima**Pilha:** 3V, CR1632**Duração da pilha:** aprox. 2000 medições (usando uma pilha nova)**Classe IP:** IP67**Normas de referência:** EN 12470-3, termômetros clínicos; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11**Duração expectativa de utilização:** 5 anos ou 10000 medições

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

**Garantia**

É concedida uma garantia vitalícia após a data de compra. Esta garantia não cobre quaisquer danos causados por manuseamento indevido. A

**PT**

garantia também não cobre a pilha nem a embalagem. Não serão consideradas quaisquer outras reclamações relativas à danos. O pedido de reclamação da garantia deverá ser enviado juntamente com o recibo de compra. Embale corretamente o instrumento avariado e envie com os portes adequados para o distribuidor Microlife.

**Beschrijving van deze thermometer**

- (1) Multifunctieknop  
(2) Display  
(3) Deksel batterijcompartiment  
(4) Meetsensor  
(5) Lichaamsmodus  
(6) Waterbadmodus  
(7) Omgevingsmodus

**Belangrijke veiligheidsinstructies**

- Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie voorziet u van belangrijke bedienings- en veiligheidsvoorschriften betreffende dit apparaat. Lees de documentatie zorgvuldig door voordoor ingebuiken van het apparaat en bewaar het voor latere raadpleging.
- De meetdijt tot het geluidssignaal moet zonder uitstrekking minimaal aangehouden!
- Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op het gevaar van verstrikking, indien het apparaat is voorzien van kabels of slangen.
- Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons of radioinstallaties. Zorg voor een afstand van minimaal 3,3 meter van dit soort apparaten, wanneer u dit apparaat in gebruik neemt.
- Bescherm het instrument tegen schokken en vallen!
- Bug de tip niet meer dan 45°!
- Vermijd omgevingstemperaturen van meer dan 60 °C. Kook het instrument NOoit!
- Gebruik altijd desinfecterende middelen vermeld in de paragraaf «Reinen en desinfecteren».
- Wij adviseren het instrument elke twee jaar op nauwkeurigheid te testen of na een mechanische schok (b.v. valen). Neem a.u.b. contact op met Microlife om een test te regelen.

**WAARSCHUWING:** De gemeten temperatuur met dit apparaat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het getal resultaat.

Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huisvuurgebied.

Lees alvoren dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.

**Geleverd onderdeel type BF****De thermometer aanzetten**

Om de thermometer aan te zetten drukt u de multifunctieknop (1) in; een korte piep geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is en het display licht rood en groen op. Een weergavestert wordt uitgevoerd.

Alle functiemogelijkheden worden weergegeven.

**Functiestest**

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt constateerd (meting onnauwkeurig), wordt dit aangegeven door «Err» in het display, en meten is dan niet meer mogelijk. In dit geval moet de thermometer worden vervangen.

**Selecteren van de meetmodus**

Druk op de multifunctieknop (1) om de gewenste meetmodus te selecteren; het apparaat zal de gekozen modus na 3 seconden instellen wanneer er niet meer gewisseld wordt. Na het voltooien van de modusselectie worden ingeschakeld.

**Huishoudelijke gebruik**

Een korte piep geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is en het display licht rood en groen op. Een weergavestert wordt uitgevoerd.

**WAARSCHUWING:** De gemeten temperatuur met dit apparaat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het getal resultaat.

Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huisvuurgebied.

Lees alvoren dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.

**Geleverd onderdeel type BF****Energieopvoeringhouder**

De energieopvoeringhouder is een uniek ontwerp van de Microlife. De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterijen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

**Waarschuwing:** De batterijen kunnen worden ingeschakeld via de batterijcompartiment (3).

Om de energieopvoeringhouder te activeren moet de batterij