

## Description of this Thermometer

EN

- Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11  
Expected service life: 5 years or 10000 measurements  
This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.  
Technical alterations reserved.

## Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

## Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button (1); a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display (2) automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field (2). The thermometer is now ready for use.

## Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

## Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.


To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button (1). Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

## Reviewing the last Measurement

When turning on the thermometer, the last measurement will be displayed with a «M» for memory.

## Measuring methods / Normal body temperature

**In the armpit (axillary) / 34.0 - 37.3 °C**  
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor (4) under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beeps.**WARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersiella disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring och desinficering» för att rengöra utrustningen och för undvika skador på utrustningen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd endast det kommersielle disinfektionsmedlet listat i sektion «Rengöring og desinficering» for å rense utstyringen og for å unngå skader på utstyringen.****VARNING:** Det er henthaltsmåttet som er håndtids med dette instrumentet ikke hanteras av små barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Varmeden om risker för stryrning i det fall detta instrument är utstrad med kablar och slängar.**Använd end**

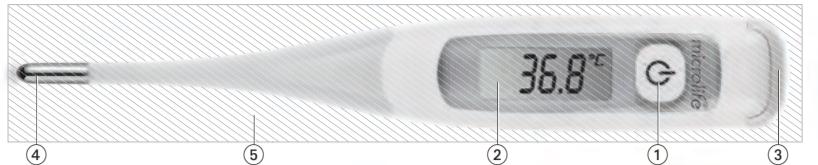

## Termometra apraksts

- ① Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLEĢT)
- ② Display
- ③ Bateriju nodalījuma vācīņš
- ④ Mērišanas sensors/mērišanas uzgalls
- ⑤ Tīrīšanas un dezinfekcijas laukums (visa termometra virsma)

LV

- Baterija: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)  
Baterijas dzēriņuma termins: apmēram 4500 mērījumi (lietot jaunu bateriju)  
IP klasē: IP67  
Atsaue uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Paredzētais lietderīgās kalpošanas termins: 5 gadi vai 10000 mērījumi

Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm. Tieks saglabāties tīsības veikti tehniskas izmaiņas.

## Garantija

Uz šo instrumentu attiecas garantija, kas ir spēkā 2 gadi pēc lietotnes dienas. Šajā garantijas periodā, pēc mūsu iestekiem, Microlife bez maksas remontēs vai nomainīs bojāto iestrādājumu.

Ja instruments tiek atvērti vai ja tajā kaut kas tiek izmainīts, garantija zaudē spēku.

Garantija neieteicas uz sekojošo:

- Transporta izmaksas un riski.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas vai lietošanas instrukcijas neievērošanās dēļ.
- Bateriju noplūdes radītie bojājumi.
- Negadījumai vai nepareizas lietošanas radītie bojājumi.
- Lepakojuma/uzglabāšanas materiāls un lietošanas instrukcija.
- Piederumi un nolejotumi pakājētās daļas: baterija.

• Piederumi un nolejotumi pakājētās daļas: baterija.

• Pārējiem pārbaudēm un apkope (kalibrēšanai).

• Kompenšācijai tiek izstrādājuma vērtību. Garantijai tiks piešķirta, ja visz strādājums tiks atzītrs kopā ar sākotnējo režīmu.

• Instrumenti nemest zemē un pārķert pret triecienu!

• Neizmēģiniet termometru zonā varīgāk par 45°!

• Izvainieties no situācijas, kad apķatējās vides temperatūra pārsniez 60 °C. NEKAD nevienāt izstrādājumu!

• Lai izvairītos no ierīces bojājumiem tīrīšanas laikā, tīrīšanai izmantojiet tikai to komerciālos dezinfekcijas līdzekļus, kas norādīti sadājā "Tīrīšana un dezinfekcijas".

• Leteicams pārējiem vidiem vai pēc mehāniskas ietekmes (piemēram, ja tāk tiek nomesta) pārbaudīt šīs ierīces precīzitāti. Lai veiktu pārbaudi, līdzīgi arī ierīces varējot Microlife-servisu.

**UZMANĪBA:** Šīs ierīces parādītās mēriņuma rezultāts nav diagnosti! Nepārbaudījiet ierīci, ja vienīgi uz mēriņuma rezultātu.

Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālīkvidē saskarīja ar vietējo likumošanu, nevis jāzīmēt sadzīves atkritumos.

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt norādījumus.

Aizsardzības klasē: BF

## Termometra iestēšanā

Lai iestēgtu termometru, nospiestiet ON/OFF pogu ①; iss skanas signāls signalizē, ka "termometrs ir iestēgts". Tieks veikts displeja tests. Jāzūsta viss segmenti.

Pēdējais mēriņuma no lasījumiem 2 sekundes automātiski tiek parādīts displejs ② ar "M" simbolu.

Pēc tam, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 32 °C, displeja lauciņā ② tiek parādīts "L" un mirgojošs "C". Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.

## Funkcijonēšanas tests

Termometra parādītās mēriņuma rezultātu var ievērtēt, ja tiek apliecināts, ka ierīces neprécizitāte, displejā parādās pārādītās pārīšanas "ERR" un mēriņu veikt līdz nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.

## Termometra lietošanā

Izvēlieties nepieciešamo mēriņuma metodi. Veicot mēriņu, displejā tiek attēlotās reālās temperatūras un "C" simbols mirgo. Mēriņuma beigas apstiprina skājas signāls, kas atskaitā 10 reizes, simbols "C" varīgs nemirgo. Ķermena temperatūras ir noteikta. Mēriņuma rezultāts tiek parādīts displejā.

10 išskanas signāls atlāknēs, ja temperatūra ir augstāka par 37,5 °C, lai brīdinātu pacientu, ka viņam/viņai varētu būt drudzis. Atsaucē:

Temperatūra, mērītās arī.

Lai iegūtu salīdzināmus rezultātus, veiciet atķārtotu mēriņumu pēc 1 minūtes intervala.

Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, tās nospiest ON/OFF pogu ①. Pretēja gadījumā termometrs automātiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.

## Pēdējā mēriņuma caurskrātīšana

Leslēdot termometru, pēdējais mēriņums tiek parādīts ar "M" atnīrias simbolu.

## Mēriņu metodes / Normāla ķermena temperatūra

Padūsu / 34,7 - 37,3 °C  
Noslēkotā padūsu ar sausūs dienās. Novietojiet mēriņšānu sensoru ④ padūsu centrālā tālā, lai gaisa pleskatos ādai, un novietojiet pacienta roku blakus pacienta ķermenim. Tas nodrošina, ka tās gaisa iestieki mēriņumam nebūs mēriņu. Tā kā padūsu neprécizitātēs vairāk laika, lai sasniegtu savu stabību temperatūru, gaidiet vīsmāz 5 minūtes, neatkarīgi no pīkstāšanas skānas.Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C  
10 minūtes pirms mēriņuma nedēdot un nedējet nekādu karst vai aukstu. Mutē galīgi aizvērtātīlā līdz 2 minūtiem pirms mēriņuma sākuma.

Novietojiet termometru vienā no dienēm iedobumiem zem mēles - pa labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mēriņšānu sensoru ④ ir jābūt saskarībā ar audīju. Aizveriet muti un vienmērīgi elpjiet caur degunu, lai novērstu ielopātā/pelēptā gaisa iestieki uz mēriņumu. Tās nav iespējams aizpirstoti elpjēt, dēļ jāzīmēt cits mēriņu.

## Apstiprinātais mēriņuma iegūšanai: 10 sek.

Anālatīa atvērē (tālīzna zārnā) / 36,6 - 38,0 °C  
Uzmanīgi ievadiet termometra mēriņšānu sensoru ④ 2-3 cm anālatīā atvērē.

Leteicams izmantojiet zondes vācīnu un smērīnu.

Ja neesat pārliecināts par šī mēriņšānu metodi, sazinieties ar speciālistu, lai saņemtu norādījumus/apmācību.

Apstiprinātais mēriņuma iegūšanai: 10 sek.

## Tīrīšana un dezinfekcijas

Dezinfekcijai mājas viēdājumā 70% izopropilspīti salveti vai kovīnības salveti, kas samitrināja 70% izopropilspīti, vai noīrīši virsma pīkstāmās no termometra zondes. Viennērā saīseti tīrīšanu no termometra zondes gādi (apstiprinēt termometru) virzīšanai uz termometra galu. Pēc tam visi termometri (skatīt ⑤ numuru attēlu) vīsmāz uz 5 minūtiem (jaugrojums 70% izopropilspīti (maks. 24 stundas). Tādēļ iemērķās (aujiet) dezinfekcijas līdzekļus nozīmēt 10 minūti pirms māksamās lietošanas.

Profesionālai lietošanai: Varat lietot zondes pārsegū (pieejams kā piederums). Saīseti arī Microlife, lai iegūtu skāku informāciju par termometra modeļiem piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem.

## Bateriju nodalījuma

Kad uz displeja parādās "V" simbols (otrādi apgrēzts trīsstūris), baterija ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nodalījumā bateriju, neņemiet bateriju nodalījuma vācīņu ③ no termometra. Leteiciet jaunu bateriju ar + zīmi uz augšu. Pārliecināties, ka jums ir tāda paša veida baterija noīrīši. Ja baterijas var iegādāties jebkārā elektronisko preču veikalā.

## Techniskās specifikācijas

Veids: Maksimums termometrs

Mēriņšāns diapazons: 32,0 - 43,0 °C

Temp. &lt; 32,0 °C: displejā parādās "L" (low), kas noīrīši zēma temp. (pīkstāma).

Temp. &gt; 43,0 °C: displejā parādās "H" (high), kas noīrīši augsta temp. (pīkstāma).

Darbības nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvi maksimālais mitrums

Uzglabāšanas nosacījumi: 25 - 60 °C; 15-95 % relatīvi maksimālais mitrums

## Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

## Valymas ir dezinfekcija

Dezinfekcijai namā salīgumis termometro zondūi nušķūstoši naudojite 70% izopropilspīku alkoholu. Šķūstuši prādejite nuo termometro viduri matavimo zondā kryptīti. Po to pamierītēt termometru ⑤ līdz 70% izopropilspīku bēni 5 minūtēm (bet ne ilgās 24 val.).

Istrākā termometru mōdotūvīnā 1 min.

Naudojant godymo istājotie patēriņi naudojite vākēnības apsauģes (papildomai (sīgumā priedas). Dēļ tīkamo dezinfektantu parādījumu būtību pasīksojotu ar Microlife astovās.

## Bateriju pakētīšana

Ekranā dešinējā apācījā parādīs "V" simbols signalizuoja, kad matīnīmo elementu iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Nākotnēmās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.

Ligikaudne mōdotūvīnā: 10 sekundītē

Pārascolest (rektālēt) / 36,6 - 38,0 °C

Sīsetāgājās matīnības iestākoties pīkstāmās (lietot jaunu bateriju).

Aytirkā matavimo trukmē 10 sek.