

microlife[®]



Microlife BP AG1-20




EN	→	1
LT	→	6
LV	→	10
EE	→	14
RU	→	18
FI	→	22

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
www.microlife.com

CE0044

IB AG1-20 N-V6 4017

microlife[®]

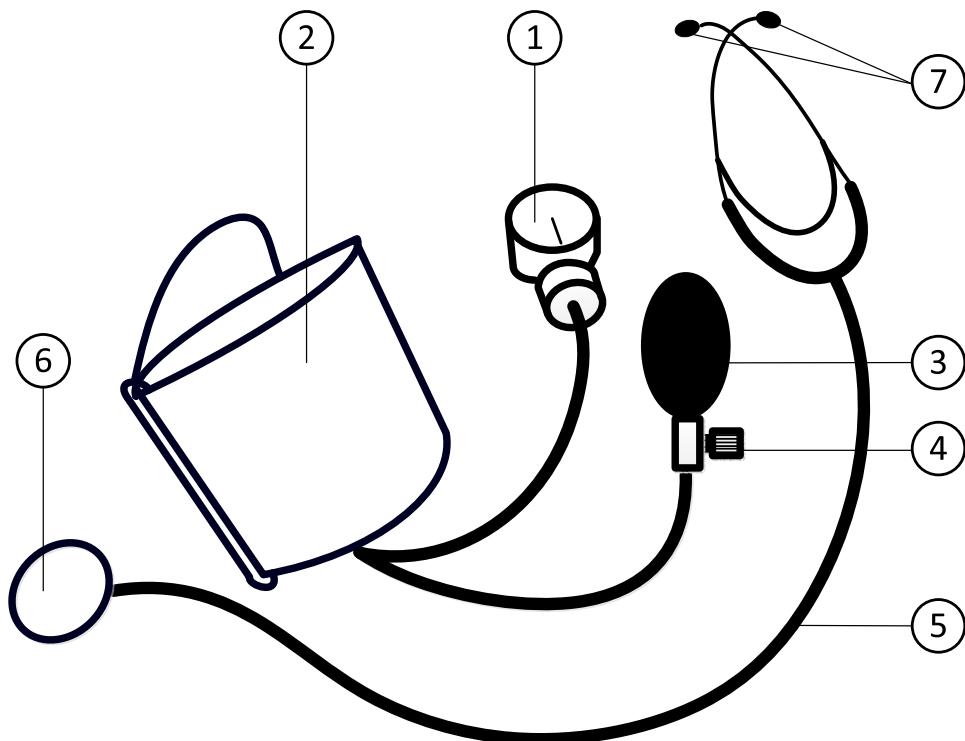

Name of Purchaser / Pircēja vārds / Pirkējo
pavardē / Ostja nimi / Ф.И.О. покупателя /
Ostajan nimi

Serial Number / Sērijas numurs / Serijos
numeris / Seerianumber / Серийный номер /
Sarjanumero

Date of Purchase / Iegādes datums /
Pardavimo data / Ostukuupev / Дата покупки /
Ostopäivämäärä

Specialist Dealer / Speciālists - pārstāvis /
Pardavusi istaiga / Ametlik müügiesindaja /
Специализированный дилер / Alan kauppias

- ① Manometer
- ② Cuff
- ③ Pump ball
- ④ Adjustable deflation valve
- ⑤ Stethoscope
- ⑥ Chest piece
- ⑦ Ear piece

Dear Customer,
this aneroid blood pressure kit is a mechanical blood pressure measuring device for use on the upper arm and ensures you a precise and consistent measurement.
Please read through these instructions carefully so that you understand all functions and safety information. We want you to be happy with your Microlife product. If you have any questions or problems please contact your local Microlife-Customer Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you the address of the Microlife dealer in your country. Alternatively, visit the internet at www.microlife.com where you will find a wealth of invaluable information on our products.
Stay healthy – Microlife AG!



Read the instructions carefully before using this device.

Table of Contents

- 1. Important Facts about Blood Pressure and Self-Measurement**
 - How do I evaluate my blood pressure?
- 2. Using the Device for the First Time**
 - Selecting the correct cuff
- 3. Taking a Blood Pressure Measurement using this Device**
 - Checklist for taking a reliable measurement
 - Measuring procedure
- 4. Malfunction / Troubleshooting**
- 5. Safety, Care, Accuracy Test and Disposal**
 - Safety and protection
 - Device care
 - Cleaning the cuff
 - Accuracy test
 - Disposal
- 6. Guarantee**
- 7. Technical Specifications**
Guarantee Card (see Back Cover)

1. Important Facts about Blood Pressure and Self-Measurement

- **Blood pressure** is the pressure of the blood flowing in the arteries generated by the pumping of the heart. Two values, the **systolic** (upper) value and the **diastolic** (lower) value, are always measured.
- **Permanently high blood pressure values can damage your health and must be treated by your doctor!**
- Always discuss your values with your doctor and tell him/her if you have noticed anything unusual or feel unsure. **Never rely on single blood pressure readings.**
- There are many causes of excessively **high blood pressure values**. Your doctor will explain them in more detail and offer treatment where appropriate. Besides medication, relaxation techniques, weight loss and exercise can also lower your blood pressure.
- **Under no circumstances should you alter the dosages of any drugs prescribed by your doctor!**
- Depending on physical exertion and condition, blood pressure is subject to wide fluctuations as the day progresses. **You should therefore take your measurements in the same quiet conditions and when you feel relaxed!** Take at least two measurements per day, one in the morning and one in the evening.
- It is quite normal for two measurements taken in quick succession to produce significantly **different results**.
- **Deviations** between measurements taken by your doctor or in the pharmacy and those taken at home are quite normal, as these situations are completely different.
- **Several measurements** provide a much clearer picture than just one single measurement.
- **Leave a small break** of at least 15 seconds between two measurements.
- If you are **pregnant**, you should monitor your blood pressure very closely as it can change drastically during this time!

How do I evaluate my blood pressure?

Table for classifying home blood pressure values in adults in accordance with the international Guidelines (ESH, AHA, JSH). Data in mmHg.

Range	Systolic	Diastolic	Recommendation
blood pressure too low	▼ 100	▼ 60	Consult your doctor
1. blood pressure optimum	100 - 130	60 - 80	Self-check
2. blood pressure elevated	130 - 135	80 - 85	Self-check
3. blood pressure too high	135 - 160	85 - 100	Seek medical advice
4. blood pressure dangerously high	160 ▲	100 ▲	Urgently seek medical advice!

The higher value is the one that determines the evaluation.

Example: a blood pressure value of **140/80 mmHg** or a value of **130/90 mmHg** indicates «blood pressure too high».

2. Using the Device for the First Time

Selecting the correct cuff

When choosing the correct size cuff the arm circumference should be measured at the centre of the upper arm. 22 - 32 cm (8.75 - 12.5 inches) should be the correct size for the majority of people.

- ☞ Only use Microlife cuffs.
- Contact your local Microlife Service if the enclosed cuff ② does not fit.

3. Taking a Blood Pressure Measurement using this Device

Checklist for taking a reliable measurement

1. Avoid activity, eating or smoking immediately before the measurement.
2. Sit down for at least 5 minutes before the measurement and relax.
3. Always measure on the same arm (normally left).
4. Remove close-fitting garments from the upper arm. To avoid constriction, shirt sleeves should not be rolled up - they do not interfere with the cuff if they are laid flat.
5. Always ensure that the correct cuff size is used (marking on the cuff).
 - Fit the cuff closely, but not too tight.
 - Make sure that the cuff is positioned 2 cm above the elbow.

- The **artery mark** on the cuff (ca. 3 cm long bar) must lie over the artery which runs down the inner side of the arm.
 - Support your arm so it is relaxed.
 - Ensure that the cuff is at the same height as your heart.
6. Any improper setup or damage to the stethoscope will cause distorted sound or poor sound transmission causing inaccurate readings.
- 7. Proper deflation rate is essential for an accurate reading.**
- Practice and master a recommended deflation rate of 2-3 mmHg per second or a drop of 1-2 marks on the manometer ① for each heartbeat.

Measuring procedure

- Place the chest piece ⑥ underneath the cuff ② or 1-2 cm below it. Make sure the chest piece is in contact with the skin and lies on the brachial artery.
- Plug in the ear piece ⑦ and check, if the chest piece is placed correctly, so that the Korotkoff sounds appear the loudest.
- Close the valve ④ on the pump ball ③ by turning the screw clockwise. Do not over-tighten.
- Take the pump ball ③ in your free hand (the arm you are not using to measure) and pump up the cuff. Watch the pressure indicator on the manometer ① and pump up to approx. 40 mmHg higher than the expected systolic value (the upper value).
 - Inflate to 200 mmHg if you are not sure about the expected value.
- Open the valve ④ slowly by turning the screw counter clockwise whilst holding the stethoscope chest piece ⑥ on the brachial artery. Listen carefully as the cuff begins to deflate. Note the reading on the manometer ① as soon as you hear a faint, rhythmic tapping or thumping sounds. **This is the systolic blood pressure reading.**
- Allow the pressure to continue dropping at the same deflation rate. Note the reading on the manometer ① as soon as the thumping sound stops. **This is the diastolic blood pressure reading.**
- Deflate the cuff completely.
- Repeat the measurement at least two further times and record your values, date and time immediately after finishing the measurements.
- Remove the cuff and the stethoscope.

4. Malfunction / Troubleshooting

If problems occur when using the device, the following points should be checked and if necessary, the corresponding measures are to be taken:

Description	Potential cause and remedy
The sound transmission is poor, distorted or there is extraneous noise.	<ul style="list-style-type: none"> Check the ear pieces if they are dirty or cracked. If not, make sure you wear them properly. Check the tube if it is broken or twisted. Check the chest piece if there is any damage. Make sure the chest piece is in contact with the skin and lies on the brachial artery. Clean or replace any defective parts if found to avoid inaccurate reading.
The pressure does not rise although the pump ball ③ is pumping.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the valve is closed. Make sure the cuff is properly connected to bulb and manometer. Check if the cuff, tube and/or bulb is leaking. Replace the defective parts if any.
The deflation rate can not be set to 2-3 mmHg/sec. by adjusting the valve ④.	Disassemble the valve from pump ball to check if there is any blockage in the airway of the valve. Clean the blockage and try again. If it still does not work, replace it to avoid inaccurate readings.
The manometer needle is not at 0 ± 3 mmHg at rest.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the valve is completely open for zero check. If still more than 3 mmHg deviation, contact your dealer to recalibrate the manometer.

 If you think the results are unusual, please read through the information in «Section 1.» carefully.

5. Safety, Care, Accuracy Test and Disposal

Safety and protection

- This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the «Technical Specifications» section.
- Protect it from:
 - water and moisture
 - extreme temperatures
 - impact and dropping
 - contamination and dust
 - direct sunlight
 - heat and cold
- The cuffs are sensitive and must be handled with care.
- Only pump up the cuff once fitted.
- Never inflate beyond 300 mmHg.
- Always deflate the cuff completely before storage.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- Never open this device.
- Read the additional safety information provided within the individual sections of this instruction manual.

 Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

Device care

Clean the device only with a soft, dry cloth.

Cleaning the cuff

Carefully remove spots on the cuff with a damp cloth and soapsuds.

 **WARNING:** Do not wash the cuff in a washing machine or dishwasher!

Accuracy test

We recommend this device is tested for accuracy every 2 years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife-Service to arrange the test (see foreword).

Disposal



Electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

6. Guarantee

This device is covered by a **2 year guarantee** from the date of purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer (see back) confirming date of purchase or the receipt.

- Cuffs and parts that become worn with use are not included.
- Opening or altering the device invalidates the guarantee.
- The guarantee does not cover damage caused by improper handling, accidents or non-compliance with the operating instructions.

Please contact your local Microlife-Service (see foreword).

7. Technical Specifications

Weight:	450 g
Dimensions:	175 x 70 x 103 mm
Storage conditions:	-20 - +70 °C 85 % relative maximum humidity
Operating conditions:	10 - 40 °C
Measurement range:	0 - 300 mmHg
Resolution:	2 mmHg
Static accuracy:	within ± 3 mmHg between 18 - 33 °C; within ± 6 mmHg between 34 - 46 °C

Pressure reduction

rate: 2-3 mmHg/sec.

Air leakage: < ± 4 mmHg/min

Hysteresis error: within 0 - 4 mmHg

Included accessories: M-cuff (22-32 cm), pump ball, valve, stethoscope, softbag

Reference to standards:

EN ISO 81060-1; ANSI / AAMI SP09

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

- ① Manometras
- ② Manžetė
- ③ Balionėlis
- ④ Reguliuojamas išleidimo vožtuvas
- ⑤ Stetoskopas
- ⑥ Stetoskopo galvutė
- ⑦ Ausinės

Gerb. Pirkėjau,

Šis aneroidinis kraujospūdžio matavimo komplektas yra mechaninis kraujospūdžio matavimui ant žasto skirtas prietaisas, užtikrinantis tikslius atskartojančius rezultatus.

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir susipažinkite su visomis prie-taiso funkcijomis bei atsargumo priemonėmis. Tikimės, kad šis Microlife prietaisas pateisins Jūsų lūkesčius. Iškilus klausimams ar problemoms, kreipkitės į Microlife klientų aptarnavimo tarnybą. Prietaisa pardavusi įstaiga ar vaistinė jums praneš Microlife vandinės serviso tarnybos adresą. Platesnė informacija apie mūsų produktus pateikta internete adresu www.microlife.lt.
Būkite sveiki su Microlife AG!



Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.

Turinys

- 1. Svarbi informacija apie kraujospūdį ir savarankišką jo matavimą**
 - Kaip įvertinti savo kraujospūdį?
- 2. Naudojimasis prietaisu pirmą kartą**
 - Manžetės pasirinkimas
- 3. Kraujospūdžio matavimas**
 - Patikimo matavimo patarimai
 - Matavimo procedūra
- 4. Galimi gedimai / jų šalinimas**
- 5. Atsargumo priemonės, priežiūra, tikslumo patikrinimas, utilizavimas**
 - Atsargumo priemonės bei sauga
 - Prietaiso priežiūra
 - Manžetės valymas
 - Tikslumo patikrinimas
 - Utilizavimas
- 6. Garantija**
- 7. Techninės specifikacijos**
Garantijos kortelė (Žr. paskutinį viršeli)

1. Svarbi informacija apie kraujospūdį ir savarankišką jo matavimą

- Kraujospūdis - krauko slėgis į arterijų sienelės, atsirandantis dirbant širdžiai. Visą laiką matuojami du kraujospūdžio dydžiai - sistolinis (viršutinis) ir diastolinis (apatinis).
- Nuolatos padidėjės kraujospūdis žalingas Jūsų sveikatai ir turi būti gydomas!
- Visuomet su gydytoju aptarkite savo kraujospūdžio matavimo rezultatus bei išsakykite jam savo pastebėjimus ar abejones. Niekuomet nepasikliaukite vienkartinio kraujospūdžio matavimo duomenimis.
- Yra daug pernelyg aukšto kraujospūdžio atsiradimo priežasčių. Gydytojas jums placiau paaškins situaciją ir, jei reikia, paskirs gydymą. Be vaistų, kraujospūdių sumažinti padeda atsipalaide-vimo pratimai, sumažėjęs antsvoris, mankšta.
- **Niekada nekeiskite gydytojo paskirtų vaistų ar jų dozių!**
- Priklausomai nuo fizinės būsenos bei savaičių kraujospūdžio dienos bėgyje kinta. Kraujospūdžiui visą laiką matuokites vienodomis ramybės sąlygomis! Kraujospūdžiu matuokites bent du kartus per dieną - rytę ir vakare.
- Normalu, kad dvielę matavimų, atliktų vienas po kito, rezultatai skiriasi.
- Skirtumai tarp matavimų, atliktų gydytojo kabinete ar vaistinėje yra iprastas reiškinys dėl sunkiai palyginamų matavimo sąlygų.
- Keletas matavimų kraujospūdžiui atspindi tiksliau, nei vienkartinis matavimas.
- Tarp dvielę matavimų būtina padaryti bent 15 sekundžių trukmės trumpą pertraukėlę.
- Nėštumo metu kraujospūdžiui būtina matuotis labai tiksliai, nes pokyčiai gali būti labai dideli!

Kaip įvertinti savo kraujospūdį?

Kraujospūdžio matavimo namų sąlygomis duomenų klasifikacija pagal tarptautines gaires (ESH, AHA, JSH). Duomenys pateikiti mmHg.

Zona	Sistolinis kraujospūdis	Diastolinis kraujospūdis	Rekomendacijos
	↓ 100	↓ 60	Pasitarkite su gydytoju
1. Optimalus kraujospūdis	100 - 130	60 - 80	Savarankiškai matuokites kraujospūdžių
2. Padidėjės kraujospūdis	130 - 135	80 - 85	Savarankiškai matuokites kraujospūdžių
3. Per aukštąs kraujospūdis	135 - 160	85 - 100	Kreipkitės į gydytoją
4. Pavojingai padidėjės kraujospūdis	160 ↑	100 ↑	Skubiai kreipkitės į gydytoją!

Aukštėsnė išmatuota reikšmė yra pagrindas kraujospūdžio vertinimui.

Pavyzdys: kraujospūdžio reikšmė 140/80 mmHg ar 130/90 mmHg parodo «padidėjusį kraujospūdžių».

2. Naudojimasis prietaisu pirmą kartą

Manžetės pasirinkimas

Parenkant tinkamo dydžio manžetę reikia išmatuoti žasto apimties jo viduriu. 22 - 32 cm dydys tinkta daugumai žmonių.

☞ Naudokites tik Microlife manžetėmis!

► Jei pakuočėjė esanti ② manžetė Jums netinka, kreipkitės į vietinių Microlife servisą.

3. Kraujospūdžio matavimas

Patikimo matavimo patarimai

1. Pries kraujospūdžio matavimą venkite fizinės veiklos, nevalgykite ir nerūkykite.
2. Ramiai pasėdėkite bent 5 minutes ir atsipalauduokite.
3. Visuomet matuokite ant tos pačios rankos (paprastai kairės).
4. Pašalinkite nuo žaksto pernelyg glaudžiai prigludusius drabužius. Kad nespaustų arterijos, marškiniu rankovę palikite neatratotą.
5. Visuomet naudokitės tinkamo dydžio manžete (žr. ženklinimą ant manžetės).
 - Manžetę užvyniokite glaudžiai, bet neužveržkite
 - Manžetės apatinis kraštas turi būti 2 cm aukščiau rankos linkio.
 - **Arterijos žyma** ant manžetės (3 cm ilgio juostelė) turi būti vidinėje rankos puseje virš arterijos.

- Ranką padékite patogiai ir atpalaiduokite.
 - Manžetę turi būti širdies lygyje.
6. Neteisingai surinktas ar pažeistas stetoskopas iškraipo garsą, sutrikus garso perdavimą ir taip salygoja netikslų matavimą.
7. **Tinkamas oro išleidimo greitis yra esminis tikslaus matavimo faktorius.** Pasapraktikuokite, kad išmoktumėte išleisti orą 2-3 mmHg/sek. greičiu arba per 1-2 manometro ① padalas tarp dvejų širdies dūžių.

Matavimo procedūra

- Priglauskite stetoskopą galvutę ⑥ po manžetės ② kraštu ar 1-2 cm žemiau jo. Galvutę turi gerai priglusti prie kūno ties žasto arterija.
- Istatykite ausų vamzdelius ⑦ ir patirkinkite, ar galvutę priglausta taisyklingsi, ar Korotkovo tonai girdimi garsiausiai.
- Uždarykite guminės kriausės ③ oro vožtuvą, ④ pasukdami varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi. Vožtuvu neperveržkite.
- Laisva ranka suimkite kriausę ③ ir pumpuokite į manžetą orą. Stebédami manometrą ① rodyklę pumpuokite tol, kol pasieksite slėgi, 40 mmHg didesnį, nei laukiamas sistolinis (viršutinis) kraujospūdis.
 - Jei nesate tikri, pumpuokite iki 200 mmHg.
- Lėtai atidarinėkite oro vožtuvą ④ pasukdami varžtą prieš laikrodžio rodyklę ir laikydami stetoskopą galvutę ⑥ ant žasto arterijos. Atidžiai klausykités. Užfiksukite manometrą ① rodyklės padėti tuo momentu, kai išgirsite dukslius ritmingus tonus. **Tai yra sistolinio kraujospūdžio rodmenys.**
- Leiskite spaudimui kristi tuo pačiu greičiu. Užfiksukite manometrą ① rodyklės padėti tuo momentu, kai dukslus tonai išnyks. **Tai yra diastolinio kraujospūdžio rodmenys.**
- Visiškai išleiskite orą pro vožtuvą.
- Kraujospūdį matuokite bent du kartus, o gautus rodmenis užsi- rašykite, pažymédami datą ir laiką.
- Nusiimkite manžetę ir stetoskopą.

4. Galimi gedimai / jų šalinimas

Jei naudojant prietaisą iškyla sunkumų, reikia patikrinti toliau išvardintus punktus ir, jei reikia, imtis atitinkamų priemonių:

Apaščias	Galimos priežastys ir veiksmai
Prastai perduodamas garsas, jis iškraipytas arba yra trukdžių.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite, ar įkištos ir neįtrūkusios ausinės. Jei ne, patirkinkite, ar jos nesusidėvėjusios. Patirkinkite, ar neįtrūkusi arba nesusikusi žarnelė. Patirkinkite, ar nepažeista galvutė. Patirkinkite, ar galvutė gerai prigludus prie odos ir ar ji yra ties žasto arterija. Jei reikia, nuvalykite arba pakeiskite pažeistas dalis, kad jos netrukdytų gauti teisingus rezultatus.
Slėgis nekyla, nors kriausė ③ orą pumpuoja.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite, ar uždarytas vožtuvas. Patirkinkite, ar manžetė gerai pritvirtinta prie guminės kriausės ir manometro. Patirkinkite, ar manžetė, guminė kriausė ir/ar žarnelė neleidžia oro.
Negalima nustatyti 2-3 mmHg/s oro išleidimo greičio reguliuojant oro vožtuvą ④.	At junkite vožtuvą nuo guminės kriausės ir patirkinkite, ar vožtuvu kanaluose néra jokių kliūčių. Pašalinkite kliūties ir paméginkite dar kartą. Jei vožtuvas neveikia, pakeiskite jį.
Nenaudojamo manometro rodyklė nestovi 0 ± 3 mmHg padėtyje.	<ul style="list-style-type: none"> Patirkinkite, ar vožtuvas pilnai atidarytas kalibravimui. Jei nukrypimas daugiau kaip 3 mmHg, kreipkitės į vietinį atstovą dėl prietaiso kalibravimo.

☞ Jei, Jūsų nuomone, gauti rezultatai yra neįprasti, įdėmias perskaitykite informaciją, pateiktą skyriuje «1.».

5. Atsargumo priemonės, priežiūra, tikslumo patikrinimas, utilizavimas

Atsargumo priemonės bei sauga

- Prietaisai galima naudoti tik šioje instrukcijoje nurodytais tikslais. Gamintojas neatsako už žalą, kilusią dėl neteisingo prietaiso naudojimo.
- Prietaise yra jautrių komponentų, todėl naudokitės juo labai atidžiai. Laikykite saugojimo ir naudojimosi taisyklių, išdėstytyų «Techninės specifikacijos» skyriuje!
- Saugokite prietaisą nuo:
 - vandens ir drėgmės
 - aukštos temperatūros
 - sukrėtimo ar smūgių
 - dulkių ir purvo
 - tiesioginių Saulės spindulių
 - karščio ir šalčio
- Manžetės lengva pažeisti, todėl elkitės su jomis atsargai.
- Pumpuokite tik tinkamai uždėtą manžetę.
- Nepumpuokite oro daugiau nei iki 300 mmHg.
- Pabaigę naudotis visuomet pilnai išleiskite orą iš manžetės.
- Nesinaudokite prietaisu, jei manote, kad jis sugadintas, ar pastebėjote ką nors neįprasta.
- Prietaiso neardykitė.
- Daugiau apie atsargumo priemones skaitykite kituose instrukcijos skyriuose.

 Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu; kai kurios datėlės yra labai smulkios ir vaikai jas gali prarysti. Prietaisu, tiekiamu su laidais ir vamzdeliais, atveju yra pasmaugimo pavojus.

Prietaiso priežiūra

Prietaisai valykite minkštą ir sausa šluoste.

Manžetės valymas

Valykite manžetę drėgna šluoste ar kempinéle.

 **DÉMESIO:** Neskalbkite manžetės skalbimo mašinoje ar indaplovėje!

Tikslumo patikrinimas

Kas 2 metus arba po mechaninio poveikio (pvz. nukritus ant grindų) rekomenduojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl tikslumo patikrinimo kreipkitės į vietinį Microlife servisą.

Utilizavimas



Elektroniniai prietaisai turi būti utilizuojami laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Negalima prietaiso išmesti su buitinėmis šiukslėmis.

6. Garantija

Prietaisui suteikiama **2 metų garantija** nuo pardavimo datos. Garantija galioja tik pateikus užpildytą garantijos kortelę bei pirkimo čekį.

- Ši garantija netaikoma manžetei ir besidévinčioms dalims.
- Prietaiso atidarymas ar kitoks jo modifikavimas nutraukia garantijos galiojimą.
- Garantija negalioja pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, nelaimingų atsitikimų ar instrukcijų nesilaikymo. Prašome kreiptis į vietinį Microlife servisą (Žr. įzanga).

7. Techninės specifikacijos

Svoris: 450 g

Dydis: 175 x 70 x 103 mm

Saugojimo sąlygos: -20 - +70 °C
85 % santykinė maksimali drėgmė

Darbinės sąlygos: 10 - 40 °C

Matavimo ribos: 0 - 300 mmHg

Raiška: 2 mmHg

Statinis tikslumas: ± 3 mmHg nuo 18 - 33 °C;
± 6 mmHg nuo 34 - 46 °C

Slėgio kritimo tempas: 2-3 mmHg/sek.

Oro išleidimas: < ± 4 mmHg/min

Histerezės klaida: tarp 0 - 4 mmHg

Itraukių piedai: M-manžetė (22-32 cm), balionėlis,
vožtuvas, stetoskopas, détuvė

Standartų nuorodos: EN ISO 81060-1; ANSI / AAMI SP09

Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Galimi techniniai pakeitimai.

- ① Manometrs
- ② Manšete
- ③ Gumijas bumbieris
- ④ Regulējams gaisa izlaišanas vārsts
- ⑤ Stetoskops
- ⑥ Stetoskopa galviņa
- ⑦ Uzgaļi ausīm

Cien./god. lietotāj!

Šī aneroīda asinsspiediena mēritāja komplekts ir mehāniska asinsspiediena mērišanas ierīce lietošanai uz augšdelma, kas nodrošina precīzu un konsekventu mērījumu.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo instrukciju, lai izprastu visas funkcijas un drošības informāciju. Mēs vēlamies, lai Jūs būtu apmeklēti ar Microlife izstrādājumu. Ja Jums rodas kādi jautājumi vai problēmas, lūdzam sazināties ar Microlife vietējo klientu apkalošanas dienestu. Ierīces pārdevējs vai aptiekārs palīdzēs Jums noskaidrot Microlife izplatītāja adresi Jūsu valstī. Jūs varat arī apmeklēt tīmekļa vietni www.microlife.lv, kur atradīsiet plašu un vērtīgu informāciju par mūsu produktiem.

Lai Jums laba veselība – Microlife AG!



Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt norādījumus.

Saturs

- 1. Svarīgi fakti par asinsspiedienu un tā noteikšanu, pašam veicot mērījumu**
 - Kā es varu novērtēt savu asinsspiedienu?
- 2. Instrumenta izmantošana pirmo reizi**
 - Pareizas manšetes izvēle
- 3. Asinsspiediena mērišana, izmantojot šo instrumentu**
 - Norādījumi ticama mērijuma veikšanai
 - Mērišanas procedūra
- 4. Darbības traucējums / problēmu novēršana**
- 5. Drošība, kopšana, precīzitātes tests un likvidēšana**
 - Drošība un aizsardzība
 - Instrumenta kopšana
 - Manšetes tīrīšana
 - Precīzitātes tests
 - Likvidēšana
- 6. Garantija**
- 7. Tehniskā specifikācija**
Garantijas talons (skatīt otru pusī)

1. Svarīgi fakti par asinsspiedienu un tā noteikšanu, pašam veicot mērījumu

- Asinsspiediens ir artērijas plūstošo asiņu spiediens, ko rada sirdsdarbība. Vienmēr tiek mēritas divas vērtības: **sistoliskais** (augšējais) un **diastoliskais** (apakšējais) asinsspiediens.
- **Pastāvīgi augsts asinsspiediens var kaitēt Jūsu veselībai, un šādā gadījumā Jums ir jāvēršas pie ārst!**
- Vienmēr pārrunāt savu asinsspiedienu ar ārstu, un informēt viņu, ja esat pamanijis kaut ko neparastu vai kādas neskaidrības. **Nekad nepauties uz vienu asinsspiediena mērījumu.**
- Pastāv vairāki iemesli, kāpēc ir vērojams pārmēriģi **augsts asinsspiediens**. Jūsu ārsts pastāstīs par tiem sīkāk un, ja nepieciešams, piedāvās ārstēšanas kursu. Papildus medikamentiem Jūsu asinsspiedienu var samazināt arī relaksācijas metodes, svara zaudēšana un fiziski vingrinājumi.
- **Nekādā gadījumā nemainīt zāļu devu, ko Jums noteicis ārsts!**
- Atkarībā no fiziskās slodzes un sagatavotības asinsspiediens dienas gaitā var ļoti mainīties. **Tāpēc ir ieteicams veikt asinsspiediena mērījumus vienmēr vienādos mierīgos apstākļos, kad esat atpūtēs!** Veikt vismaz divus mērījumus vienā: vienu no rīta un vienu vakarā.
- Tas ir normāli, ja, veicot divus mērījumus pēc kārtas, tiek uzrādīti ievērojami **atšķirīgi rezultāti**.
- **Atšķirības** mērījumu rezultātos, kas iegūti pie Jūsu ārsta vai aptiekāra, un rezultātos, kas iegūti mājas apstākļos, ir normāla parādība, jo šīs situācijas ir pilnīgi atšķirīgas.
- **Vairāki mērījumi** sniedz daudz skaidrāku priekšstatu, nekā viens mērījums.
- **Levērojiet nelielu**, vismaz 15 sekunžu pauzi starp diviem mērījumiem.
- Ja esat **stāvoklī**, Jums vajadzētu rūpīgi sekot savam asinsspiedienam, jo šajā periodā tas var ievērojami mainīties!

Kā es varu novērtēt savu asinsspiedienu?

Tabula asinsspiediena vērtību klasificēšanai mājās pieaugušajiem saskanā ar starptautiskajām vadlīnijām (ESH, AHA, JSH). Mērvienība: mmHg.

Amplitūda	Sistoliskais	Diastoliskais	Ieteikums
pazemināts asinsspiediens	▼ 100	▼ 60	Konsultēties ar ārstu!
1. optimāls asinsspiediens	100 - 130	60 - 80	Veiciet pašpārbaudi!
2. paaugstināts asinsspiediens	130 - 135	80 - 85	Veiciet pašpārbaudi!
3. paaugstināts asinsspiediens	135 - 160	85 - 100	Meklējet medicīnisku palīdzību!
4. asinsspiediens bīstami augsts	160 ▲	100 ▲	Nekavējoties meklējet medicīnisku palīdzību!

Paaugstināta vērtība ir tā, kas nosaka novērtēšanu. Piemēram: asinsspiediena vērtība **140/80 mmHg** vai vērtība **130/90 mmHg** norāda, ka «asinsspiediens ir pārāk augsts».

2. Instrumenta izmantošana pirmo reizi

Pareizas manšetes izvēle

Izvēloties pareiza lieluma manšeti, nepieciešams izmērīt rokas apkārtmēru augšdelmu centrā. Lielākajai daļai cilvēku pareizajam manšetē lielumam ir jābūt 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 collas).

☞ Izmantot tikai Microlife manšetes!

► Sazināties ar vietējo Microlife servisu, ja komplektācijā iekļauta manšete (②) neder.

3. Asinsspiediena mērīšana, izmantojot šo instrumentu

Norādījumi ticama mērījuma veikšanai

1. Izvairīties no aktivitātēm, ēšanas vai smēķēšanas tiesi pirms mērījuma veikšanas.
2. Apsēsties vismaz 5 minūtes pirms mērījuma veikšanas un atpūtēties.
3. Vienmēr veikt mērījumu uz vienas un tās pašas rokas (parasti kreisās).
4. Atbrīvot augšdelmu no cieši pieguloša apģērba. Lai izvairītos no saspiešanas, krekla piedurknēs nevajadzētu uzrott, jo tās netraucē manšetei, ja tās ir norottītas.
5. Vienmēr nodrošināt, lai manšete būtu pareiza izmēra (atzīme uz manšetes).

- Stingri nostiprināt manšeti, bet ne pārāk cieši.
 - Pārliecināties, ka manšete ir novietota 2 cm virs elkoņa.
 - **Artērijas atzīmei uz manšetes (apmēram 3 cm gara līnija) jāatrodas uz artērijas, kas iet par rokas iekšpusi.**
 - Atbalstīt roku tā, lai tā būtu atslabīnātā stāvoklī.
 - Nodrošināt, lai manšete atrastos vienādā augstumā ar jūsu sirdi.
6. Jebkuri nepareizi uzstādījumi vai stetoskopa bojājumi radis skanās izkroplojumus vai sliktu skanās pārraidīšanu, tādēļ var rasties neprecīzi noslajumi.
7. **Piemērots gaisa izlaišanas ātrums ir svarīgs precīzai nolašanai.** Ieteicamais gaisa izlaišanas ātrums ir 2-3 mmHg sekundē vai 1-2 manometra ① zīmju samazināšanās uz katru sirdspukstu.

Mērišanas procedūra

1. Novietot stetoskopa galviņu ⑥ zem manšetes ② vai 1-2 cm zem tās. Pārliecināties ka stetoskopa galviņa saskaras ar ādu un atrodas uz pleca artērijas.
2. Ielikt ausī stetoskopu ⑦ un pārbaudīt, vai stetoskopa galviņa ir novietota pareizi, lai Korotoff skanās būtu dzirdamas visskaļāk.
3. Noslēgt gaisa vārstu ④ uz gumijas bumbiera ③, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Neaizgriezt pārāk cieši.
4. Paņemt brīvajā rokā gumijas bumbieri ③ (roka netiek izmantota mērišanai) un sūknēt manšeti. Skaitīt manometra ① spiediena indikatoru un sūknēt līdz apmēram par 40 mmHg augstāk nekā paredzamā sistoliskā vērtība (augšējā vērtība).
 - Lūdzam sūknēt līdz 200 mm Hg, ja neesat pārliecināts par aptuveno paredzamo mērišumu.
5. Lēni atvērt vārstu ④, griežot skrūvi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam un turēt stetoskopa galviņu ⑥ uz pleca artērijas. Klausīties uzmanīgi, kad manšete sāk izlaist gaisu. Atzīmēt noslājumu uz manometra ①, tīklīdz dzirdami vāji, ritmiski sitienu vai dunošas skanās. **Tas ir sistoliskā asinsspiediena rādījums.**
6. Atkārtot mērišanu vismaz divreiz. Atzīmēt noslājumu manometrā ①, ja dunošas skanās tiek pārtrauktas. **Tas ir diastoliskā asinsspiediena rādījums.**
7. Pilnībā izlaist gaisu no manšetes vārstā.
8. Atkārtot mērišanu vismaz divas reizes un ierakstīt savu iegūto vērtību, datumu un laiku tūlīt pēc mērijuma pabeigšanas.
9. Nonemt manšeti un stetoskopu.

4. Darbības traucējums / problēmu novēršana

Ja, lietojot ierīci, rodas problēmas, ir jāpārbauda šādi aspekti, un, ja nepieciešams, ir jāveic attiecīgi pasākumi:

Apraksts	Iespējamais iemesls un klūdas novēršana
Pārraidītās skanās ir slikti dzirdamas, traucētas vai pastāv papildus trokšņi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudīt vai austījas nav netīras vai ieplaisājušas. Ja nav, tad pārliecināties, ka tās labi piegūj un nav nolietotas. • Pārbaudīt, ka caurule nav bojāta vai savījušies. • Pārbaudīt, ka uz stetoskopa galviņas un diafragmas nav plauši. • Pārliecināties, ka stetoskopa galviņa atbilstoši pieskaras ādai un atrodas uz pleca artērijas mērišanas laikā. Notirīt vai nomainīt bojātās detaļas, lai iegūtu pareizus rādījumus.
Spiediens nepaaugstinās, neskatoties uz to, ka gumijas bumbieris ③ piepūšas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārliecināties, ka vārsts ir noslēgts. • Pārliecināties, ka manšete ir labi savienota ar gumijas bumbieri un manometru. • Pārbaudīt, vai nav radušās noplūdes manšete, vadā un/vai bumbieri. Nomainīt bojātās detaļas, ja tādas ir.
Izpūšanas ātrumu var noregulēt tikai kā 2-3 mmHg/sekundē, noregulējot gaisa izpūšanas vārstu ④.	Izjautk bumbiera vārstu, lai pārliecinātos, ka nekas neaizsprosto gaisa plūsmu vārstā. Iztīrīt aizspostojumus un meģināt vēlreiz. Ja tas joprojām nedarbojas, nomainīt to, lai iegūtu pareizus rādījumus.
Manometra rādītāja bultiņa miera stāvoklī neatrodas $0 \pm 3 \text{ mmHg}$ robežās.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārliecināties, ka vārsts ir pilnībā atvērts, lai veiktu nulles stāvokļa pārbaudi. • Ja joprojām saglabājas novirze, kas pārsniedz 3 mmHg, sazināties ar tirgotāju, lai atkārtoti kalibrētu manometru.

☞ Ja Jums šķiet, ka rezultāti ir neparasti, uzmanīgi izlasīt informāciju 1. sadalā.

5. Drošība, kopšana, precizitātes tests un likvidēšana

Drošība un aizsardzība

- Šo instrumentu var izmantot tikai šajā bukletā minētajam nolūkam. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Šajā instrumentā ir viegli sabojājamas sastāvdalas, tādēļ pret to ir jāizturas uzmanīgi. Nodrošiniet glabāšanas un darba apstākļus, kas aprakstīti sadaļā «Tehniskā specifikācija».
- Aizsargāt to pret:
 - ūdeni un mitrumu
 - galejām temperatūrām
 - triecieniem un nosviešanas zemē
 - piesārņojumu un putekļiem
 - tiešu saules gaismu
 - karstumu un aukstumu
- Manšētes ir viegli sabojājamas, un ar tām ir jārīkojas uzmanīgi.
- Piepildiet manšēti ar gaisu tikai tad, kad tā ir uzlikta.
- Nekad nepiepūst vairāk par 300 mmHg.
- Pirms uzglabāšanas pilnībā izlaidiet gaisu no manšētes.
- Neizmantot instrumentu, ja uzskaļtat, ka tas ir bojāts, vai ja pamanāt kaut ko neparastu.
- Nekad neatvērt instrumentu.
- Izlasiit papildu drošības norādījumus atsevišķās šī bukleta sadaļās.

 Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas tā sastāvdalas ir pietiekami sīkas, lai tās varētu norīt. Jāzīpzinās, ka ir iespējams nožņaugšanās risks, ja ierīce ir piegādāta kopā ar kabeļiem vai caurulēm.

Instrumenta kopšana

Tīrīt instrumentu tikai ar mīkstu, sausu lupatiņu.

Manšētas tīrīšana

Rūpīgi notīrīt traipus no manšetes ar mitru lupatiņu un ziepiju putām.

 **BRĪDINĀJUMS:** Nemazgāt manšeti veļas vai trauku mazgājamajā mašīnā!

Precizitātes tests

Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti ik pēc 2 gadiem vai pēc mehāniska trieciena (piemēram, pēc nomešanas zemē). Lūdzam sazināties ar vietējo Microlife servisu, lai veiktu testu (skatīt priekšvārdu).

Likvidēšana



Elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.

6. Garantija

Uz šo instrumentu attiecas **garantija, kas ir spēkā 2 gadus** pēc iegādes dienas. Garantija ir derīga, uzrādot garantijas talonu, ko aizpildījis pārdevējs (skatīt aizmugurē) un kurā apstiprināts iegādes datums, vai, uzrādot čeku.

- Garantija neatliecas uz manšeti un nodilumam paklautajām daļām.
- Ja instruments tiek atvērts vai ja tājā kaut kas tiek izmaiņīts, garantija zaudē spēku.
- Garantija nesedz zaudējumus, kas radušies neuzmanīgas lietošanas, negadījumu vai norādījumu neievērošanas dēļ.

Lūdzam sazināties ar vietējo Microlife servisu (skatīt priekšvārdu).

7. Tehniskā specifikācija

Svars:	450 g
Izmēri:	175 x 70 x 103 mm
Uzglabāšanas nosacījumi:	-20 - +70 °C 85 % relatīvais maksimālais gaisa mitrums
Darbības nosacījumi:	10 - 40 °C
Mērišanas diapazons:	0 - 300 mmHg
Izšķirtspēja:	2 mmHg
Statiskā precīzitāte:	± 3 mmHg - 18 - 33 °C; ± 6 mmHg - 34 - 46 °C
Spiediena krišanas ātrums:	2-3 mmHg/sek
Gaisa noplūde:	< ± 4 mmHg/min
Histerēzes izraisīta kljūme:	0 - 4 mmHg
Iekļauti piederumi:	M-manšete (22-32 cm), gumijas bumbieris, vārsti, stetoskops, somiņa
Atsauce uz standartiem:	EN ISO 81060-1; ANSI / AAMI SP09

Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.

Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

- ① Manomeeter
- ② Mansett
- ③ Kummiballoon
- ④ Reguleeritav öhuventtiil
- ⑤ Stetoskoop
- ⑥ Stetoskoobi otsik
- ⑦ Kõrvaotsik

Austatud klient,

See aneroidine vereröhu komplekt on mehaaniline vereröhu mõõtmise seade kasutamiseks ölavarrel ja tagab teile täpsse ja järgjepideva mõõtmise.

Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oksaksite kõiki funktsioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me soovime, et oleksite oma Microlife tootega rahul. Kui teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga.

Kohaliku Microlife esindaja aadressi saate oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalusena küllastage meie veebilehte www.microlife.ee, kust leiate väärtsiliku teavet meie toodete kohta. Tugevat tervist – Microlife AG!



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.

Sisukord

- 1. Oluline teave vereröhu ja iseendal vereröhu mõõtmise kohta**
 - Kuidas hinnata vereröhu väärtsuseid?
- 2. Aparaadi esmakordne kasutus**
 - Valige õige suurusega mansett
- 3. Vereröhu mõõtmine selle aparaadiga**
 - Olulised punktid usaldusväärsuseks tulemusteks
 - Mõõtmisprotseduur
- 4. Häired / törkeotsing**
- 5. Ohutus, hooldus, täpsustest ja kätlus**
 - Ohutus ja kaitse
 - Aparaadi hooldus
 - Manseti puhastamine
 - Täpsustest
 - Kätlus
- 6. Garantiitoodete väljatöötamine**
- 7. Tehnilised andmed**

Garantiikaart (vt tagakaant)

1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmine kohta

- Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekkitud rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - **süstoolset** (ülemist) ja **diastoolset** (alumist) vererõhku.
- Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see vajab arsti juhendatud ravi!
- Arutage oma vererõhväärtusi alati koos arstiga ja õelje talle, kui olete tähendanud midagi tavaisest erinevat või te pole milleski kindel. Ärge kunagi tugevinega ainult ühele vererõhväärtusele.
- Liiga **kõrgel vererõhul** võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab neid teile täpselt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite võivad vererõhku alandada lõögastumine, kehakaalu langetamine ja kehaline aktiivsus.
- **Ärge ühelgi juuhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!**
- Söltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk päeva lõikes oluliselt. **Seetõttu peate vererõhku mõõtmata alati samades rahulikes tingimustes ja lõögastununa!** Mõõtke vererõhku vähemalt kaks korda päevas - hommikul ja öhtul.
- Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on normaalne, kui saate märkimisväärselt **erinevad tulemused**.
- Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus mõõdetud tulemused **ei ole sarnased**, kuna need olukorrad erinevad teineteisest täielikult.
- **Korduvad mõõtmised** annavad märksa töesema pildi kui vaid üks kord mõõdetud näit.
- Jätke kahe mõõtmise vaheline vähemalt 15-sekundiline **paus**.
- Kui olete **rase**, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest see võib oluliselt muutuda!

Kuidas hinnata vererõhu väärtsuseid?

Tabel on täiskasvanu vererõhutulemuste hindamiseks ja vastab rahvusvahelistele ravijuhenditele (ESH, AHA, JSH). Ühikud on mmHg.

Vahemik	Süstoolne	Dias-toolne	Soovitus
liiga madal vererõhk	▼ 100	▼ 60	Pidage nõu arstiga
1. optimaalne vererõhk	100 - 130	60 - 80	Iseseisev kontroll
2. kõrgenenud vererõhk	130 - 135	80 - 85	Iseseisev kontroll
3. liiga kõrge vererõhk	135 - 160	85 - 100	Pöörduge arsti poolle
4. ohtlikult kõrge vererõhk	160 ↑	100 ↑	Pöörduge viivitamatult arsti poolle!

Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtsuse järgi. Näide: vererõhu väärtsus **140/80 mmHg** või **130/90 mmHg** tähendab, et «vererõhk on liiga kõrge».

2. Aparaadi esmakordne kasutus

Valige õige suurusega mansett

Valides õige suususega mansetti, tuleks mõõta ümbermõõt ölavarrre keskelt. 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 tolli) peaks olema sobiv mõõt enamikule inimestele.

☞ Kasutage ainult Microlife mansette!

► Pöörduge oma kohaliku Microlife esindaja poole, kui kaasasolev mansett ② ei sobi.

3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga

Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks

1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõögastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul).
4. Eemaldage ölavarrrelt kitsad riided. Sooniimise välitmiseks ärge käärige pliusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus on märgitud mansetile).
 - Asetage mansett ümber käe tihedalt, kuid mitte liiga tugevalt.
 - Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm künarliigesest kõrgemale.

- Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
 - Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
 - Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Vale seadistus või kahjustatud stetoskoop tekitavat moonutatud heli, või halb heli edastus põhjustavad ebaõigeid näitusid.
7. **Öige öhu väljutuskiirus tagab tulemuse korrekse lugemise.**
Harjuta ja omada soovitatav öhu väljutuskiirus 2-3 mmHg sekundis või 1-2 astet langust manomeetril ① iga südamelöögi kohta.
- Mõõtmisprotseduur**
1. Asetage stetoskoobi otsik ⑥ manseti ② ääre alla või 1-2 cm sellest allapoole. Veenduge, et stetoskoobi otsik oleks kontakti naha pinnaga ja paikneks brahhialarteril.
 2. Pange körvaotsikud ⑦ kõrva ja kontrollige kas stetoskoobi otsik on paigaldatud õigesti, nii et Kortkovi heli on hästi kuuldatav.
 3. Sulgege kummiballooni ③ öhuventtiil ④, keerates kruvi kellaosuti liikumise suunas. Ärge keerake kruvi kinni liiga kövasti.
 4. Võtke kummiballoon ③ vabasse kätte (käsivarsimill te ei mööda) ja pumbake mansett täis. Jälgitge rõhu indikaatorit manomeetril ① ja pumbake ligikaudu 40 mmHg kõrgemale oletatavast süstoolest vererõhu väärustusest (ülemine väärustus).
 - Paisutada 200 mmHg, kui te ei tea hinnangulist väärust.
 5. Avage öhuventtiil ④ aeglaselt, keerates kruvi kellaosutile vastupidiises suunas ja hoidke stetoskoobi otsikut ⑥ ölavarrarteri kohal. Kuulake tähelepanelikult kui mansett hakkab tühjenema. Märkige üles manomeetri ① väärust siis kohu kui te kuulete nõrka rütmilist kohisevat heli. **See ongi süstoolse vererõhu näit.**
 6. Jätkake rõhu langetamist aeglaselt, sama kiirusega. Märkige üles manomeetri ① näit koheselt kui rütmilne kohisev heli kaob. **See ongi diastoolse vererõhu näit.**
 7. Tühjendage mansett täielikult.
 8. Korrake mõõtmist vähemalt kaks korda ja märkige üles tulemused kuupäeva ja kellaajaga koheselt peale mõõtmise lõpetamit.
 9. Eemalda mansett ja stetoskoop.

4. Häired / törkeotsing

Kui seadme kasutamise ajal tekib probleeme, tuleb kontrollida järmisi punkte ja vajaduse korral võtta tarvitusele vastavad abinöud:

Kirjeldus	Võimalik põhjus ja kuidas toimida
Heli ülekanne on nõrk, moonutatud või seal on ekstra müra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige körvaotsikuid, kas nad on määrdunud või purunenud. Vastasel juhul veenduge, et te kannate neid õigesti. • Kontrollige toru on katki või keerutatud. • Kontrollige kas stetoskoobi otsik on terve. • Veenduge, et stetoskoobi otsik on nahal ja täpselt brahhialarteril. Puhastage või vahetage välja defektsed osad, et vältida vääraid tulemusi.
Rõhk ei töuse kuigi kummiballon ③ pumpab õhku.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et öhuventtiil on suletud. • Veenduge, et mansett on korralikult ühendatud öhuballooni ja manomeetriga. • Kontrollige, kas manseti toru ja/või öhuballoon lekib. Vajadusel asendage defektsed osad.
Deflatsioonimäära ei saa valida kuni 2-3 mmHg/sek reguleerides ventilli ④.	Kummiballoon lahti, kontrollida kas pole ummistust vooliku torudes. Vajadusel eemalda ummistas ja proovida uuesti. Kui see ikka ei tööta siis asendada see uuega, et vältida vääraid näitusid.
Rahuolekus manomeetri osutि ei näita $0 \pm 3 \text{ mmHg}$.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et öhuventtiil oleks täielikult avatud nullisse. • Kui ikka üle 3 mmHg kõrvalekalle, edasimüüjalt kalibreerimine harru.

☞ Kui teie meeles on tulemused ebatõenäolised, lugege «1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.

5. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus

⚠️ Ohutus ja kaitse

- Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekinud kahjustuste eest.

- See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja kasutustingimusi!
- Kaitseks seadet:
 - vee ja niiskuse,
 - ekstreemsete temperatuuride,
 - põruttuse ja kukkumiste,
 - määrdumise ja tolmu,
 - otseste päikesevalguse ning
 - kuuma ja külma eest.
- Manset on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
- Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
- Mitte täita mansetti üle 300 mmHg.
- Enne ladustamist tühjendage mansett täielikult.
- Ärge kasutage seadet, kui see on teie meeles kahjustunud või tähdeldab sellel midagi ebavallalist.
- Ärge ühelgi juhul seadet avage.
- Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.

 Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolukutega.

Aparaadi hooldus

Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.

Manseti puhastamine

Eemaldage plekid ettevaatlikult kasutades niisket lappi ja seebi-vahtu.

 **HOIATUS:** Ärge peske mansetti pesumasinas ega nõude-pesumasinas!

Täpsustest

Me soovitame vererõhuaparaadi mõötetäpsust kontrollida iga 2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma kohaliku Microlife esindaja poole (vt eessõna).

Käitus

 Elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi hulka.

6. Garantii

Sellele seadmele on antud **2 -aastane garantii**, mis algab ostukuu-päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi (vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.

- Garantii alla ei kuulu mansett ja kandeosad.
- Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on seda muudetud.
- Garantii ei kata valest käsitsimisest, önnetusjuhutumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest tekinud kahjustuid.

Palun võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga (vt eessõna).

7. Tehnilised andmed

Kaal:	450 g
Mõõdud:	175 x 70 x 103 mm
Hoiutingimused:	-20 - +70 °C 85 % suhteline maksimaalne niiskus
Tööttingimused:	10 - 40 °C
Mõõtevahemik:	0 - 300 mmHg
Resolutsioon:	2 mmHg
Staatiline täpsus:	jooksul ± 3 mmHg vahel 18 - 33 °C; jooksul ± 6 mmHg vahel 34 - 46 °C
Rõhu langetamise kiirus:	2-3 mmHg/sek
Öhuleke:	< ± 4 mmHg/min
Hüstereetiline viga:	jooksul 0 - 4 mmHg
Lisatud lisavarustus:	M-mansett (22-32 cm), kummiballoon, ohuveetil, stetoskoop, pehme kott

Vastavus standarditele: EN ISO 81060-1; ANSI / AAMI SP09

See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC nõuetele.

Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.

- ① Манометр
- ② Манжета
- ③ Нагнетатель
- ④ Регулируемый клапан спуска
- ⑤ Стетоскоп
- ⑥ Головка стетоскопа
- ⑦ Ушные оливы

 Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Уважаемый покупатель,
Этот механический прибор для измерения артериального давления гарантирует Вам точное и последовательное измерение.

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие указания для получения четкого представления обо всех функциях и технике безопасности. Нам бы хотелось, чтобы Вы были удовлетворены качеством изделия Microlife. При возникновении вопросов или проблем, пожалуйста, обращайтесь в местный сервисный центр Microlife. Ваш дилер или аптека могут предоставить Вам адрес дилера Microlife в Вашей стране. В качестве альтернативы, посетите в Интернете страницу www.microlife.ru, где Вы сможете найти ряд полезных сведений по нашему изделию.

Будьте здоровы – Microlife AG!

Оглавление

- 1. Важная информация об артериальном давлении и самостоятельное измерение
 - Как определить артериальное давление?
- 2. Использование прибора в первый раз
 - Подбор подходящей манжеты
- 3. Выполнение измерений артериального давления при помощи прибора
 - Рекомендации для получения надежных результатов измерений
 - Процедура измерения

- 4. Неисправности / устранение неполадок
- 5. Техника безопасности, уход, проверка точности и утилизация
 - Техника безопасности и защита
 - Уход за прибором
 - Очистка манжеты
 - Проверка точности
 - Утилизация
- 6. Гарантия
- 7. Технические характеристики
Гарантийный талон (см. на обратной стороне)

1. Важная информация об артериальном давлении и самостоятельное измерение

- Артериальное давление - это давление крови, подаваемой сердцем в артерии. Всегда измеряются два значения, систолическое (верхнее) давление и диастолическое (нижнее) давление.
- Постоянно повышенное артериальное давление может нанести ущерб Вашему здоровью, и в этом случае Вам необходимо обратиться к врачу!
- Всегда сообщайте врачу о Вашем давлении и сообщайте ему/ей, если Вы заметили что-нибудь необычное или чувствуете неуверенность. Никогда не полагайтесь на результат однократного измерения артериального давления.
- Чрезмерное повышение артериального давления может быть вызвано рядом причин. Врач разъяснит Вам это более подробно и в случае необходимости предложит метод лечения. Кроме того, медикаментозное лечение, методики снятия напряжения, снижение веса и упражнения также способствуют снижению артериального давления.
- Ни при каких обстоятельствах не меняйте дозировку любых лекарств, назначенных врачом!
- В зависимости от физических нагрузок и состояния, артериальное давление подвержено значительным колебаниям в течение дня. Поэтому каждый раз процедура измерений должна проводиться в спокойных условиях и когда Вы нечувствуете напряжения! Выполняйте по крайней мере два измерения в день, одно утром и одно вечером.
- Совершенно正常ально, если при двух измерениях подряд полученные результаты будут отличаться друг от друга.

- **Расхождения** между результатами измерений, полученными врачом или в аптеке, и результатами, полученными в домашних условиях, также являются вполне нормальными, поскольку ситуации, в которых проводятся измерения, совершенно различны.
- **Многократные измерения** позволяют получить более четкую картину, чем просто однократное измерение.
- **Сделайте небольшой перерыв**, по крайней мере, в 15 секунд между двумя измерениями.
- Во время **беременности** следует тщательно следить за артериальным давлением, поскольку на протяжении этого периода оно может существенно меняться!

Как определить артериальное давление?

Таблица для классификации значений артериального давления взрослого человека в соответствии с международными рекомендациями ESH, AHA, JSH. Данные приведены в мм.рт. ст.

Диапазон	Систолическое	Диастолическое	Рекомендация
артериальное давление слишком низкое	↓ 100	↓ 60	Обратитесь к врачу
1. оптимальное артериальное давление	100 - 130	60 - 80	Самостоятельный контроль
2. повышенное артериальное давление	130 - 135	80 - 85	Самостоятельный контроль
3. артериальное давление слишком высокое	135 - 160	85 - 100	Обратитесь за медицинской помощью
4. артериальное давление угрожающее высокое	160 ↑	100 ↑	Срочно обратитесь за медицинской помощью!

Оценка давления определяется по наивысшему значению. Например: давление **140/80** мм.рт.ст. и давление **130/90** мм.рт.ст. оба оцениваются как «артериальное давление очень высокое».

2. Использование прибора в первый раз

Подбор подходящей манжеты

При выборе правильного размера манжеты, обхват руки должен измеряться в центре верхней части руки. 22 - 32 см (8.75 - 12.5 дюймов) - это правильный размер для большинства людей.

☞ Пользуйтесь только манжетами Microlife!

► Обратитесь в местный сервисный центр Microlife, если приложенная манжета (2) не подходит.

3. Выполнение измерений артериального давления при помощи прибора

Рекомендации для получения надежных результатов измерений

1. Избегайте физической активности, не ешьте и не курите непосредственно перед измерением.
2. Перед измерением присядьте, по крайней мере, на пять минут и расслабьтесь.
3. Всегда проводите измерения на одной и той же руке (обычно на левой).
4. Снимите облегающую одежду с плеча. Не следует закатывать рукава рубашки, это может привести к сдавливанию, рукава из тонкой ткани не мешают измерению, если приподняты свободно.
5. Убедитесь, что используется манжета правильного размера (маркировка на манжете).
 - Плотно наложите манжету, но не слишком туго.
 - Убедитесь, что манжета расположена на 2 см. выше локтя.
 - **Метка артерии** на манжете (линия длиной около 3 см.) должна находиться над артерией с внутренней стороны руки.
 - Расположите руку так, чтобы она оставалась расслабленной.
 - Убедитесь, что манжета находится на той же высоте, что и сердце.
6. Неправильная установка или повреждение стетоскопа может стать причиной искаженного звука или плохой передачи звука, которые влияют на точность показаний.
7. **Правильная скорость спуска имеет важное значение для получения точности показаний.** Необходимо освоить рекомендованную скорость спуска 2-3 мм.рт.ст. в секунду или спуск 1-2 знаков на шкале манометра (1) для каждого сердцебиения.

Процедура измерения

1. Установите головку стетоскопа (6) под манжету (2) или на 1-2 см ниже манжеты. Убедитесь, что головка стетоскопа находится в контакте с кожей и лежит на плечевой артерии.
2. Вставьте ушные оливы (7); головка стетоскопа считается установленной правильно тогда, когда тон Короткова слышен как самый громкий.
3. Закройте клапан спуска (4), расположенный на нагнетателе (3), повернув винт по часовой стрелке.
4. Возьмите нагнетатель (3) подкачки в свободную руку (рука, на которой не проводятся измерения) и накачайте манжету. Наблюдайте за индикацией давления на манометре (1) и

- подкачивайте приблизительно на 40 мм рт. ст. выше, чем ожидаемое систолическое давление (верхнее значение).
- Если Вы не уверены в этой величине, накачайте манжету до давления 200 мм рт.ст..
5. Медленно откройте клапан ④, поворачивая винт против часовой стрелки, и держите головку стетоскопа ⑥ над плечевой артерией. Слушайте внимательно, как манжета начинает спускать воздух. Заметьте показание на манометре ①, как только Вы услышите четкий, ритмичный стук или биение. **Это значение является величиной систолического артериального давления.**
6. Позвольте давлению падать при той же скорости выпуска воздуха. Заметьте показание на манометре ①, как только звук биения перестает быть слышимым. **Это значение является величиной диастолического артериального давления.**
7. Полностью выпустите воздух из манжеты.
8. Повторите измерения как минимум два раза. Запишите свои измерения, а также время и дату измерения сразу же после проведения измерений.
9. Снимите манжету и стетоскоп.

4. Неисправности / устранение неполадок

Если во время использования устройства имеют место проблемы, необходимо проверить следующие моменты и предпринять соответствующие меры в случае необходимости:

Описание	Возможная причина и устранение
Плохая передача тона, искажения или посторонний шум.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте ушные оливы, если они грязные или с трещинами. Если нет, то убедитесь, что вы носите их должным образом. • Проверьте, не имеет ли трубка трещин и не перекручена ли она. • Проверьте мембранны рабочей части стетоскопа, если есть какие-либо повреждения. • Удостоверьтесь, что рабочая часть стетоскопа находится в надлежащем контакте с кожей и располагается над плечевой артерией во время измерения. Во избежание неточных измерений, прочистите или замените неисправные детали.

Описание	Возможная причина и устранение
При накачивании манжеты нагнетателем ③ давление не увеличивается.	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверьтесь, что клапан закрыт. • Удостоверьтесь, что манжета правильно подсоединенна к резиновому баллону и манометру. • Проверьте, не имеют ли манжета, трубка и/или резиновый баллон утечек. При обнаружении неисправности замените неисправные детали.
Скорость выпуска воздуха не может быть установлена на 2-3 мм рт. ст./сек	Отсоедините клапан от «груши» для того, чтобы проверить, не имеется ли препятствий для воздуха внутри клапана. Удалите препятствия и повторите попытку снова. Если клапан не работает должным образом, замените его во избежание получения неточных результатов измерений.
Стрелка манометра в состоянии покоя находится не в положении 0 ± 3 мм рт.ст.	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверьтесь, что при проверке установки нуля клапан полностью открыт. • Если отклонение от нулевого значения превышает 3 мм рт. ст., обратитесь к торговой организации для повторной калибровки манометра.

☞ Если Вам кажется, что результаты отличаются от обычных, то, пожалуйста, внимательно прочтите информацию в «Разделе 1.».

5. Техника безопасности, уход, проверка точности и утилизация

⚠ Техника безопасности и защита

- Прибор может использоваться только в целях, описанных в данном буклете. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием.
- В состав прибора входят чувствительные компоненты, требующие осторожного обращения. Ознакомьтесь с условиями хранения и эксплуатации, описанными в разделе «Технические характеристики»!
- Оберегайте прибор от:
 - воды и влаги
 - экстремальных температур
 - ударов и падений
 - загрязнения и пыли

- прямых солнечных лучей
- жары и холода
- Манжеты представляют собой чувствительные элементы, требующие бережного обращения.
- Производите накачку только наложенной манжеты.
- Никогда не накачивайте давление выше чем 300 мм рт. ст.
- Спустите полностью воздух из манжеты перед тем как ее сложить.
- Не используйте прибор, если Вам кажется, что он поврежден, или если Вы заметили что-либо необычное.
- Никогда не вскрывайте прибор.
- Прочтите дальнейшие указания по безопасности в отдельных разделах этого буклета.



Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлангами возможен риск удушения.

Уход за прибором

Используйте для чистки прибора только сухую, мягкую ткань.

Очистка манжеты

Осторожно удалите пятна с манжеты с помощью влажной тряпки и мыльной воды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стирать манжету в стиральной или посудомоечной машине!

Проверка точности

Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые 2 года либо после механического воздействия (например, падения). Для проведения теста обратитесь в местный сервисный центр Microlife (см. введение).

Утилизация



Электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятymi нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

6. Гарантия

На прибор распространяется гарантия в течение **2 лет** с даты приобретения. Гарантия действительна только при наличии гарантиного талона, заполненного дилером (см. с обратной стороны), подтверждающего дату продажи, или кассового чека.

- Гарантия не распространяется на манжету и изнашиваемые части.
- Вскрытие и механические повреждения приводят к утрате гарантии.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением, несчастными случаями или невыполнением инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, обратитесь в местный сервисный центр Microlife (см. введение).

7. Технические характеристики

Масса:	450г
Размеры:	175 x 70 x 103 мм
Условия хранения:	-20 - +70 °C максимальная относительная влажность 85 %
Условия применения:	10 - 40 °C
Диапазон измерений:	0 - 300 мм рт.ст.
Минимальный шаг индикации:	2 мм рт.ст.
Статическая точность:	в пределах ± 3 мм рт.ст, между 18 - 33 °C; в пределах ± 6 мм рт.ст, между 34 - 46 °C
Скорость выпуска воздуха:	2-3 мм рт. ст./с.
Утечка воздуха:	$< \pm 4$ мм рт. ст./мин
Погрешность запаздывания:	в пределах 0 - 4 мм рт.ст.
Комплектация:	манжета M (22-32 см), нагнетатель с клапаном, стетоскоп, сумка-чехол
Соответствие стандартам:	EN ISO 81060-1; ANSI / AAMI SP09

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/EEC.

Право на внесение технических изменений сохраняется.

- ① Manometri
- ② Mansetti
- ③ Pumpupallo
- ④ Säädetävä ilmavirtaventili
- ⑤ Stetoskooppi
- ⑥ Rintaosa
- ⑦ Korvaosa

Hyvä asiakas,

Tämä verenpaineen mittauspaketti sisältää mekaanisen aneroidi verenpaineen olkavarresta tapahtuvaan mittaanmiseen tarkasti ja toistettavasti tarkoitettun laitteen.

Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki toiminnot ja turvallisuutta koskevat tiedot. Tahdomme sinun olevan tytyväinen Microlife-tuotteeseesi. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteys paikalliseen Microlife-asiakaspalveluusi.

Saat paikallisen Microlife-jälleenmyyjän osoitteen kaupialtaasi tai apteekistasi. Voit vaihtoehtoisesti käydä www.microlife.fi-sivustolamme, josta löydät paljon tuottelimme koskevia tärkeitä tietoja.

Pysy terveenä – Microlife AG!



Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

Sisällysluettelo

- 1. Tärkeitä faktuja verenpaineesta ja omatoimisesta mittaanmisesta**
 - Miten arvioin verenpaineeni?
- 2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa**
 - Oikean mansetin valitseminen
- 3. Verenpaineen mittaus laitteen avulla**
 - Luotettavan mittauksen takaava tarkistuslista
 - Mittaaminen
- 4. Toimintahäiriö / vianmääritys**
- 5. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen**
 - Turvallisuus ja suojaaminen
 - Laitteen huolto
 - Mansetin puhdistaminen
 - Tarkkuustesti
 - Hävittäminen
- 6. Takuu**
- 7. Tekniset tiedot**
Takuukortti (katso takakantta)

1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta mittaanmisesta

- Verenpaine on valtimoissa virtaavan veren verenpaine sydämen pumpatessa verta valtimoihin. Mittauksen yhteydessä mitataan aina kaksi arvoa, **systolinen** (ylempi) arvo ja **diastolinen** (alemпи) arvo.
- **Pysyvästi korkeat verenpaineearvot saattavat olla haitallisia terveydelleesi ja niiden hoitamiseen tarvitaan lääkäri!**
- Keskustele verenpaineearvoista aina lääkärisi kanssa ja kerro hänelle, jos olet huomannut jotakin erikosta, tai jos olet epävarmaa jostakin. **Älä milloinkaan luota yksittäisiin verenpainelukemiin.**
- Lian korkeisiin verenpaineearvoihin on olemassa monia syitä. Lääkärisi selittää niiden merkityksen yksityiskohtaisesti ja ehdottaa tarpeen tullen hoitoa. Paita lääkitys, myös rentoutusteknikat, painon pudotus ja liikunta voivat alentaa verenpainettasi.
- **Sinun ei tule missään tapauksessa muuttua lääkärisi määräämää lääkeannoksi!**
- Verenpaine vahitellee suuresti päivän aikana riippuen fyysisestä kuormituksesta ja kunnosta. **Tämän takia sinun tulisi suorittaa mittaus aina samoisesta rauhallisissa olosuhteissa ja silloin kun tunnet olevasi rentoutunut!** Suorita mittaus ainakin kaksi kertaa päivässä, kerran aamulla ja kerran illalla.
- On normaalista, että kaksi peräkkäin tehtyä mittautua antaa **toisistaan huomattavasti eroavia tuloksia.**
- **Erot lääkärisi tai apteekkisi suorittamiin mittausten ja kotona saamiesi tulosten välillä ovat normaaleja, koska nämä tilanteet ovat aivan erilaiset.**
- **Useamat mittaukset** antavat paljon selvemmän kuvan kuin ainoastaan yksi mittaus.
- Jätä kahden mittauksen väliin **pieni, vähintään 15 sekunnin mittainen tauko.**
- Jos olet **raskaana**, sinun tulisi tarkkailla verenpainettasi huolellisesti, koska se saattaa vaihdella merkittävästi tämän ajanjakson aikana!

Miten arvioin verenpaineen?

Taulukko kotona mitattavien verenpaineearvojen luokittelun aikuisilla kansainvälisten ohjeistusten mukaisesti (ESH, AHA, JSH). Tiedot muodossa mmHg.

Vaihteluväli	Systolinen	Diastolinen	Suositus
liian alhainen paine	▼ 100	▼ 60	Käänny lääkärin puoleen
1. optimaalinen verenpaine	100 - 130	60 - 80	Omatoiminen seuranta
2. kohonnut verenpaine	130 - 135	80 - 85	Omatoiminen seuranta
3. liian korkea verenpaine	135 - 160	85 - 100	Ota yhteyttä lääkäriin
4. vaarallisen korkean verenpaine	160 ▲	100 ▲	Ota kiireisesti yhteyttä lääkäriin!

Korkeampi arvo määritää arvioinnin. Esimerkki: verenpaineearvo 140/80 mmHg tai 130/90 mmHg ilmaisee «liian korkeaa verenpaineen».

2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa

Oikean mansetin valitseminen

Oikeaa mansettikokoaa valitessa, mitataa yläkäsivarren keskikohta. Koko 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 inches) pitäisi olla sopiva koko useimille ihmisille.

☞ Käytä ainoastaan Microlife-mansetteja!

► Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi, jos toimitettu mansetti ② ei sovi.

3. Verenpaineen mittaus laitteen avulla

Luotettavan mittauksen takaava tarkistuslista

1. Vältä fyysisiä aktiiviteetteja, syömistä ja tupakointia välittömästi ennen mittautusta.
2. Istudu vähintään 5 minuutiksi ennen mittautua - ja rentoudu.
3. Mittaa aina samasta käsivarresta (normaalisti vasemmassa).
4. Poista tiukka vaatetus käsivarrelta. Paidan hihat voivat kiristää, jos ne käärääntyvät ylös. Sileät ja kiristämättömät hihat eivät haittaa mansetin käyttöä.
5. Varmista aina, että käytössä on oikean kokoinen mansetti (kts. merkintä mansetissa).
 - Aseta mansetti ihmomyötäisesti, mutta älä liian tiukalle.
 - Varmista, että mansetti on sijoitettu 2 cm kynnarpään yläpuolelle.

- Mansetissa olevan **valtimo-merkin** (noin 3 cm pitkä palkki) tulee sijaita käsivarren sisäpuolella olevan valtimon päällä.
 - Tue käsivartesi niin, että se on rentona.
 - Varmista, että mansetti on samalla korkeudella sydämessä kassaa.
6. Sopimaton tai vahingoittunut stetoskooppi voi vääristää äänen tai antaa vain heikon äänen ja näin epätarkan tuloksen.
- 7. Sopiva ilman poispäästämisen vauhti on tärkeää tarkan tuloksen saamiseksi**, joten harjoittele, sillä paras ilman poislaskuvauhti on 2-3 mmHg /sekuntti tai 1-2 merkin paineen pudotus ① mittaväliseessä joka sydämenlyönnillä.

Mittaaminen

- Aseta stetoskoopin ⑥ rintakappale mansetin ② alle tai 1-2 cm sen alapuolelle. Varmista, että rintakappale on ihmisen kassassa ja olkavarsilaskimon yläpuolella.
- Laita stetoskoopin korvakappleet ⑦ korviin ja varmista että rintakappale on oikealla paikalla, jotta kuulet Korotkoffin äänentäytäntöä.
- Sulje pumpussa ③ oleva ilmaventtiili ④ käänämällä ruuvia myötäpäivään. Älä ylikiristä.
- Pumppaa ilmapumppua ③ vapaalla kädelläsi (käsi, jota et käytä mittauksessa) ja täytä mansetti. Katso manometrin ① paineen osoittaja ja pumppaa noin 40 mmHg yli odotetun systolisen verenpaineesi (korkeampi arvo).
 - Jos et ole varma arvosta, niin täytä mansetti ensin 200 mmHg.
- Avaa hitaasti ilmaventtiili ④ käänämällä ruuvia vastapäivään ja pidä stetoskoopin rintakappaleita ⑥ olkavarsilaskimon yläpuolella. Kun mansetti alkaa tyhjentyä, kuuntele huolellisesti. Ota manometrin ① lukema heti ylös, kun kuulet heikon rytmisen tai hakaavan äänen. **Tämä on systolinen verenpainelukema.**
- Anna paineen jatkaa putoamistaan. Lue manometrin ① lukema heti, kun heikko, rytminen ääni loppuu. **Tämä on diastolinen verenpainelukema.**
- Tyhjennä mansetin venttiili täydellisesti.
- Toista mittaus vähintään kaksoi kertaa ja tallenna arvot välittömästi, päävärimäärä, kellonaika, kun mittaus on valmis.
- Poista mansetti ja stetoskooppi.

4. Toimintahäiriö / vianmääritys

Jos mittauksen aikana ilmenee jokin vika, niin seuraavat asiat pitää tarkistaa ja jos tarpeellista niin vastaava mittaus pitää tehdä uudelleen:

Kuvaus	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Äänen toisto on heikko, vääristynyt tai siellä on ylimääräisiä häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että korvaosat eivät ole likaisia tai säröillä. Jos eivät, varmista että käytät niitä oikein. Tarkasta, että letku ei ole rikki tai kierrettävä. Tarkista, että välikalvossa tai rintakappaleessa ei ole halkeamia Varmista, että rintakappale on täysin kiinni ihossa ja olkavarsilaskimon yläpuolella mittauksen aikana. Puhdistaa tai vaihda jokainen vahingoittunut osa välittääksesi epätarkan tuloksen.
Paine ei nouse, vaikka pumppupallo ③ pumppaa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että venttiili on kiinni. Varmista, että mansetti on kiinnitetty hyvin pumppuun ja manometriin. Tarkista, että mansetti, ilmaputki ja/ tai pumppu ovat ehjä. Vaihda mahdolliset rikkinaiset osat.
Ilman poispäästämäis ④ ei voida säätää 2-3 mmHg/sekuntti.	Purkaa venttiili pumpupallo ja tarkista onko ilmaventtiili tukossa. Poista tukos ja yritys uudelleen. Jos se ei vieläkään toimi, vaihda uusi venttiili välityäksesi epätarkoitelta tuloksilta.
Manometri osoitin ei ole $0 \pm 3 \text{ mmHg}$ levossa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että venttiili on täysin auki nolla kohdan tarkistamiseksi. Jos edelleen enemmän kuin 3 mmHg ero, ota yhteyttä jälleenmyyjään manometrin uudelleen kalibroimiseksi.

☞ Jos tulokset ovat mielestäsi poikkeuksellisia, lue huolellisesti «osiossa 1.» olevat tiedot.

5. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen

Turvallisuus ja suojaaminen

- Täitä laitetta saa käyttää ainoastaan näissä ohjeissa mainittuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Laitteessa on herkkia osia ja sitä täytyy käsittää varoen. Noudata säälytys- ja käyttöolosuhdeita koskevia neuvoja, jotka on mainittu «Tekniset tiedot» -kappaleessa!
- Suojaa laitetta seuraavilta:
 - vesi ja kosteus
 - äärimmäiset lämpötilat
 - iskut ja putoamiset
 - liika ja pöly
 - suora auringonvalo
 - kuumuus ja kylmyys
- Mansetit ovat herkkia ja niitä täytyy käsittää varoen.
- Pumppaa ilmaa mansettiin ainoastaan silloin kun se on asetettu paikoilleen.
- Älä koskaan täytä mansettia yli 300 mmHg.
- Tyhjennä mansetti aina kokonaan ennen säilyttämistä.
- Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai jos huomaat jotakin epätavalista.
- Älä koskaan pura laitetta.
- Lue myös tämän kirjasen muissa kappaleissa olevat turvallisuusohjeet.

 Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäväksi. Ole tietoinen tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, että laitteen mukana toimitetaan kaapeleita ja putkia.

Laitteen huolto

Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla kankaalla.

Mansetin puhdistaminen

Puhdista mansetti varovasti kostealla liinalla.

 **VAROITUS:** Älä pese mansettia pyykinpesukoneessa tai astianpesukoneessa!

Tarkkuustesti

Suosittelemme laitteen tarkkuuden testaamista joka 2. vuosi tai mekaanisen iskun jälkeen (jos laite on esim. päässyt putoamaan). Järjestä testaikaa ottamalla yhteyttä paikalliseen Microlife-palveluusi (katso johdanto).

Hävittäminen



Elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.

6. Takuu

Laitteella on **2 vuoden takuu** ostopäivästä lukien. Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhteydessä esitetään kauppiaan täyttämä takuu kortti (katso takakantra), joka vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.

- Takuu ei koske mansettia eikä kuluvia osia.
- Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
- Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä, onnettomuuksista tai käyttööhjeiden noudattamatta jättämisestä. Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi (katso johdantoa).

7. Tekniset tiedot

Paino: 450 g

Mitat: 175 x 70 x 103 mm

Säälytysolosuhheet: -20 - +70 °C
85 % suhteellinen maksimaalinen kosteus

Käyttöolosuhheet: 10 - 40 °C

Mittausalue: 0 - 300 mmHg

Resoluutio: 2 mmHg

Staattinen tarkkuus: rajoissa \pm 3 mmHg in 18 - 33 °C;
rajoissa \pm 6 mmHg in 34 - 46 °C

Paineine laskunopeus: 2-3 mmHg/s.

Ilman vuoto: < \pm 4 mmHg/min

Hystereesi-virhe: rajoissa 0 - 4 mmHg

Mukana tarvikkeet: M-mansetti (22-32 cm), pumpupallo,
venttiiliit, stetoskooppi, säälytyslaukku

Viittauiset normeihin: EN ISO 81060-1; ANSI / AAMI SP09

Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista asetettuja vaatimuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.